Sillón Belate Med

Ficha de consulta rápida

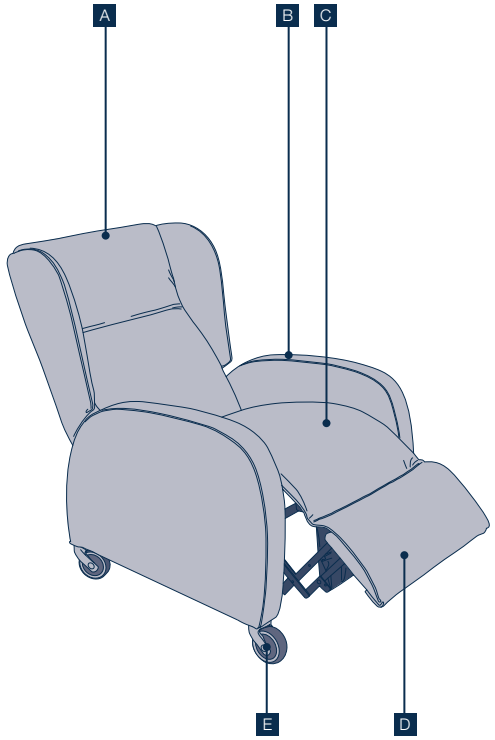

Componentes del sillón

A	Respaldo	D	Reposapiernas
B	Reposabrazos	E	Ruedas de Ø10 cm
C	Asiento		

Otras funciones del sillón

Ruedas y sistema de frenado

Para el transporte de pacientes, ya sea para movilidad en la habitación o para traslados más amplios, el sillón incorpora ruedas de Ø10 cm con un freno individual en cada una de las ruedas traseras.

- Activar freno: Pisar el pedal hasta su posición más baja, al activar el freno la rueda se bloqueará.
- Desactivar freno: Levantar con el pie el pedal hasta que quede en su posición más alta.



Ruedas traseras de Ø10 cm con freno individual

Limpieza

Se recomienda limpiar la unidad con detergente y agua tibia. No utilice una cantidad excesiva de líquido ni productos de limpieza abrasivos.

Limpieza y desinfección diaria

- Respaldo, asiento, reposapiernas y reposabrazos.

Limpieza y desinfección después de la salida de un paciente o antes de un traslado:

- Respaldo, asiento, reposapiernas y reposabrazos y freno.

Limpieza y desinfección a fondo cada dos meses:

- Todo el sillón.

Mantenimiento

Comprobar siempre el estado correcto de:

- Ruedas.
- Mecanismos de frenado.
- Componentes mecánicos de accionamiento de respaldo y reposapiernas.

Para más información, diríjase al manual de uso y mantenimiento.

www.pardo.es
SERVICIO TÉCNICO
(+34) 976 300 033

sept 2026 | CódPCO700685_FichaRapida_BelateMed_ES_2020_rev.03

Operación mecánica

Regulación del respaldo y reposapiernas

Abatir respaldo y extender reposapiernas:

- Para abrir el sistema y obtener la primera posición (2) es necesario ejercer una presión con la zona lumbar, ayudándose con los brazos, a la vez que levanta los pies (1).
- Para obtener la segunda posición (3) o posición de descanso, se debe hacer una presión con los hombros sobre el respaldo.

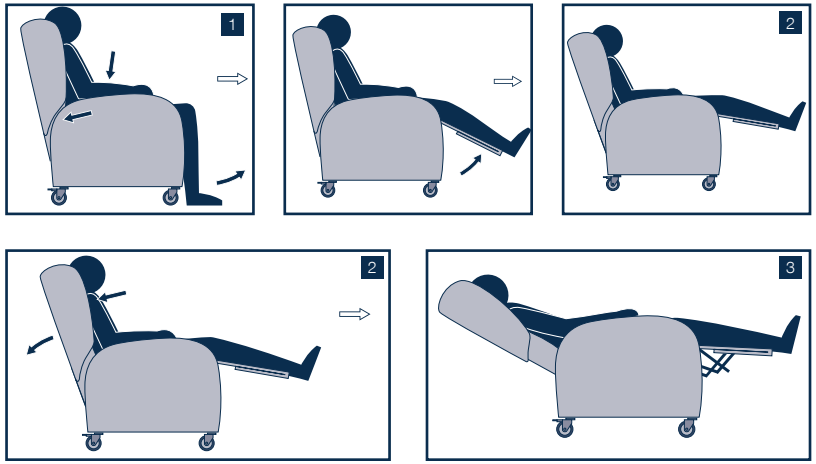

Abatir respaldo y extender reposapiernas

Elevar respaldo y recoger reposapiernas:

- Para cerrar el mecanismo desde la posición de descanso (3), levantar un poco la espalda del respaldo del sillón para volver a la primera posición (2).
- Para volver a la posición inicial (1), se ha de ejercer una presión con las piernas sobre el reposapiernas.

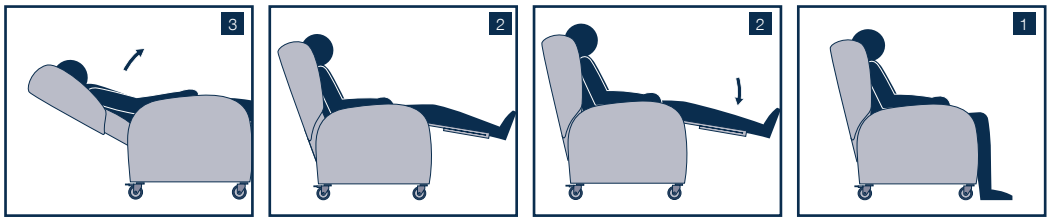

Elevar respaldo y recoger reposapiernas

Accesorios

Portasueros

- El portasueros se sitúa en un soporte (1) que va situado en uno de los laterales del sillón.
- Sistema de sujeción de **dos ganchos** con capacidad de 2 kilogramos por gancho.

Ganchos portadrejes

- El sillón puede disponer de un soporte metálico en el lateral (2) para incluir la varilla portadrenajes y los ganchos para las bolsas de drenajes o diuresis.
- Existen dos opciones disponibles:
  - Dos ganchos fijos y metálicos
  - Dos ganchos regulables y plásticos

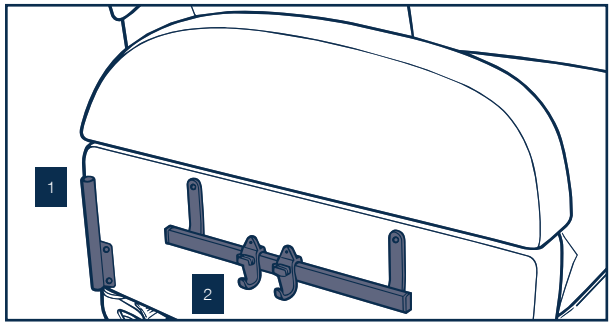

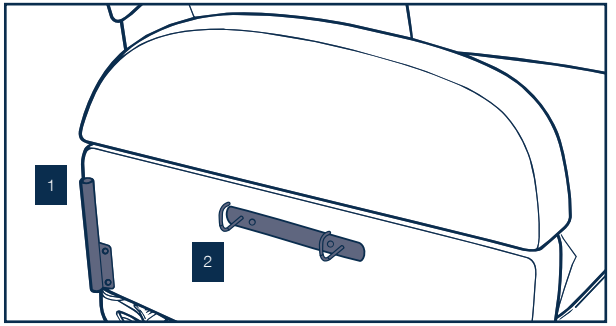

La empresa Industrias Hidráulicas Pardo S.L. cuenta con los siguientes certificados:

IQNET LTD · AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD · AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SANITARIOS · AENOR GESTIÓN AMBIENTAL · AENOR ECODISEÑO · CE MD

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- No sentarse sobre el respaldo para evitar falta de estabilidad del sillón o roturas por sobrepeso. Manejar con cuidado el tramo piernas a la hora de elevarlo o recogerlo con el fin de evitar aplastamientos en las manos.
- No sentarse sobre el reposabrazos para evitar la falta de estabilidad del sillón o roturas por sobrepeso.
- Manejar con cuidado el tramo piernas a la hora de elevarlo o recogerlo con el fin de evitar aplastamientos en las manos.
- En caso de que no se transporte el sillón o el paciente, deberá activarse el freno de todas las ruedas ya que podrían producirse daños si éste llegara a desplazarse accidentalmente.

pardo

Industrias Hidráulicas Pardo, S.L. C/ Los Ángeles 5, (Polígono Centrovía) - 50198 La Muela, Zaragoza (Spain)