Sillón C-Class

Ficha de consulta rápida

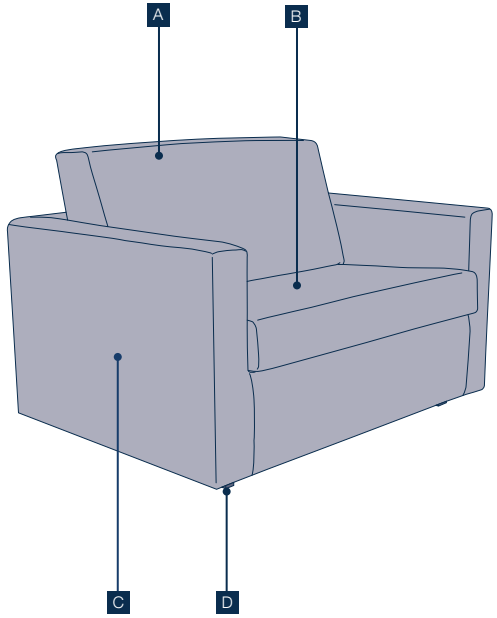

Componentes del sillón

A	Respaldo	C	Reposabrazos integrados
B	Asiento	D	4 patas

Otras funciones del sillón

Convertible en cama individual:

Estos sillones están diseñados para su utilización por los acompañantes de los pacientes, por lo que se puede colocar en dos posiciones para su comodidad:

- Posición sillón (1)
- Posición cama individual (2)

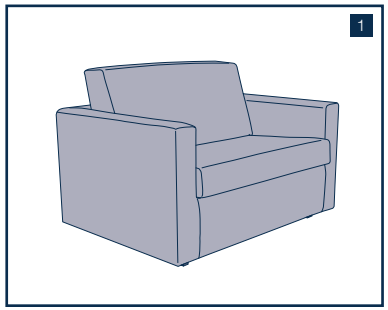

Posición sillón

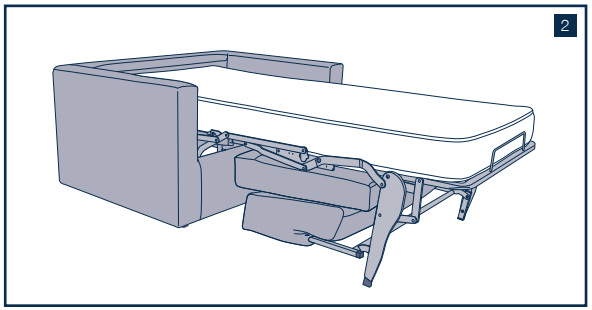

Posición cama individual

Limpieza

Se recomienda limpiar la unidad con detergente y agua tibia. No utilice una cantidad excesiva de líquido ni productos de limpieza abrasivos.

Limpieza y desinfección diaria:

- Respaldo, asiento, reposabrazos.

Limpieza y desinfección después de la salida de un paciente o antes de un traslado y a fondo cada dos meses:

- Todo el sillón.

Mantenimiento

Comprobar siempre el estado correcto de:

- Mecanismo de conversión en cama.

Para más información, diríjase al manual de uso y mantenimiento.

www.pardo.es
SERVICIO TÉCNICO
(+34) 976 300 033

jul 2024 | Cód: PCO701554_FichaRapida_C-Class_ES_2024

Operación mecánica

Extensión del sillón

Para proceder a convertir el sillón en cama seguir los siguientes pasos:

- Acceder a la cama oculta en el interior del sillón sin necesidad de extraer los cuerpos (1).
- Tirar hacia arriba de la estructura plegada de la cama.
- Seguir tirando hasta que la estructura quede totalmente extendida, en posición horizontal y las patas apoyen en el suelo, quedando el conjunto en posición de cama individual (2).

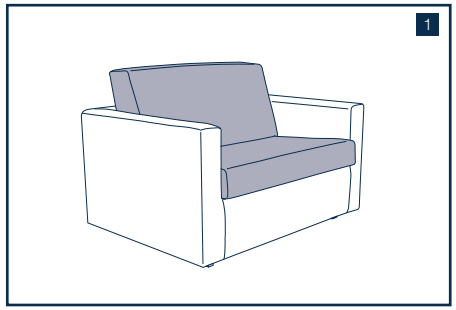

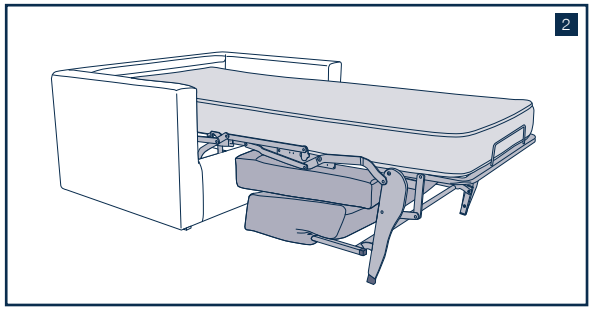

Extensión del sillón

Recoger sillón:

Para volver el sillón a su posición original proceder de manera inversa:

- Tirar hacia arriba del arquillo del piecero para que la estructura de la cama empiece a plegarse.
- Empujar y acompañar a la estructura para su correcto plegado en el interior del hueco del sillón.
- Comprobar que el respaldo y el asiento del sillón quedan correctamente colocados en posición sillón.

La empresa Industrias Hidráulicas Pardo S.L. cuenta con los siguientes certificados:

IQNET LTD · AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD · AENOR GESTIÓN CALIDAD PRODUCTOS SANITARIOS · AENOR GESTIÓN AMBIENTAL · AENOR ECODISEÑO · CE MD

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- No sentarse sobre el respaldo para evitar falta de estabilidad del sillón o roturas por sobrepeso.
- No sentarse sobre el reposabrazos para evitar la falta de estabilidad del sillón o roturas por sobrepeso.
- Manejar con cuidado la estructura de la cama a la hora de extenderla o plegarla con el fin de evitar aplastamientos en las manos.

Industrias Hidráulicas Pardo, S.L. C/ Los Ángeles 5, (Polígono Centrovía) - 50198 La Muela, Zaragoza (Spain)