Mesilla Ega

Ficha de consulta rápida

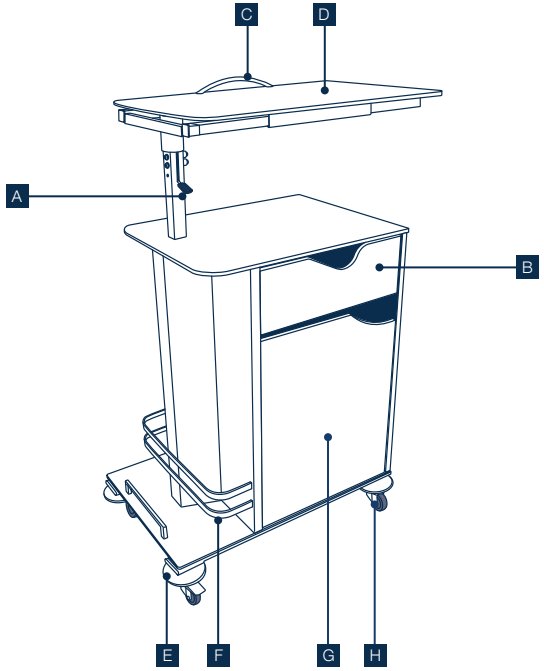

Componentes del sillón

A	Palanca de mesa sobrecama	E	Discos protectores
B	Cajón reversible	F	Portabombonas
C	Asa de tablero	G	Mueble de almacenaje
D	Mesa sobrecama	H	Ruedas de Ø 5 cm

Otras funciones de la mesilla

Ruedas:

Para su traslado, la mesilla incorpora cuatro ruedas de Ø5 cm con freno individual en dos de ellas.

Sistema de frenado:

- Activar freno: Pisar el pedal hasta su posición más baja, al activar el freno la rueda se bloqueará.
- Desactivar freno: Levantar con el pie el pedal hasta que quede en su posición más alta.





Limpieza

Se recomienda limpiar la unidad mediante el uso de soluciones de cloro con una concentración máxima de 1000 mg/l.

Limpieza y desinfección después de la salida de un paciente:

- Mesa sobrecama, asa, puertas, palanca.

Limpieza y desinfección a fondo cada dos meses:

- Toda la mesilla.

Mantenimiento

Comprobar siempre el estado correcto de:

- Ruedas.
- Cajones, puertas.
- Elevación mesa.

Para más información, diríjase al manual de uso y mantenimiento.

www.pardo.es
SERVICIO TÉCNICO
(+34) 976 300 033

mar 2026 | Cód:PCO701576_FichaRapida_Ega_ES_2024_rev02

Operaciones mecánicas

Subir y bajar el atril:

- Accionar la palanca tirando hacia arriba y sujetando el tablero.
- Colocar la mesa a la altura deseada.
- Liberar la palanca.
- Para bajar el atril, accionar la palanca y empujar suavemente la tabla hacia abajo. Liberar la palanca.

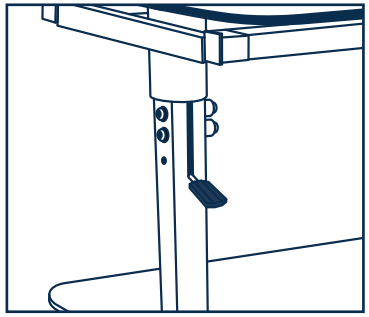

Palanca de ajuste de altura

Reclinación del tablero:

- Inclinar el tablero sujetándolo por el lado opuesto al del asa hasta alcanzar la inclinación deseada (5 posiciones).
- Para volver a la posición horizontal, inclinar el tablero hata la posición máxima y plegar.

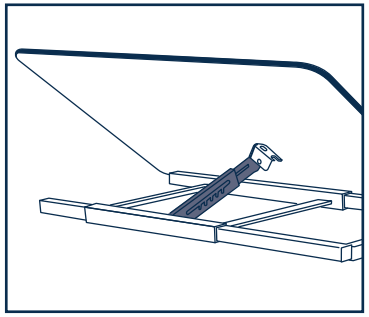

Sistema posicionamiento tablero

Reversible:

- La mesilla, el cajón y el hueco del armario son reversibles, es decir, se pueden colocar en cualquiera de las dos direcciones. Para girar la mesilla basta con girarla 180.

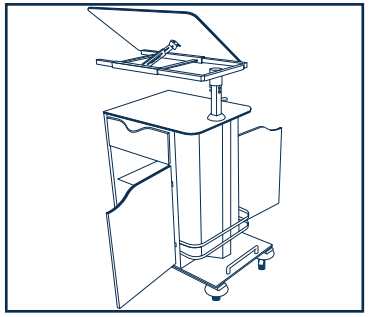

Otras operaciones mecánicas

Tablero extensible:

- La mesa de sobrecama tiene la posibilidad de ser extensible para acercarse al paciente y facilitar su uso.

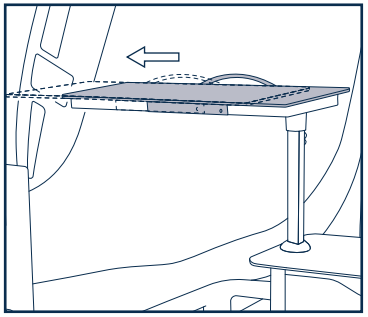

Apertura de la puerta:

- La mesilla tiene rebajes en las puertas, en el armario y en el cajón para favorecer la apertura de la misma

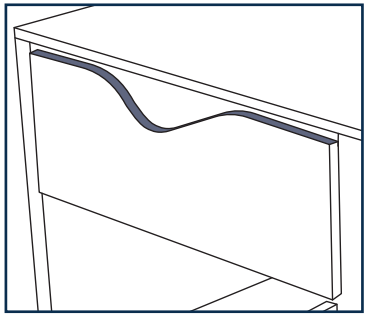

La empresa Industrias Hidráulicas Pardo S.L. cuenta con los siguientes certificados:

IQNET LTD · AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ER-0000/2010 · AENOR GESTIÓN CALIDAD PRODUCTOS SANITARIOS ER-0000/2010 · AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ER-0000/2010 · AENOR ECODISEÑO ER-0000/2010 · CE MD

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Existen riesgos de atrapamiento o aplastamiento al descender las partes móviles. Compruebe que en su descenso no se encuentra ningún obstáculo.
- Debe comprobar que no haya materiales, partes del cuerpo del usuario u otra persona cercana, que puedan interponerse entre la tabla y los elementos fijos.

pardo

Industrias Hidráulicas Pardo, S.L. C/ Los Ángeles 5, (Polígono Centrovía) - 50198 La Muela, Zaragoza (Spain)