Cama NewCare

Ficha de consulta rápida

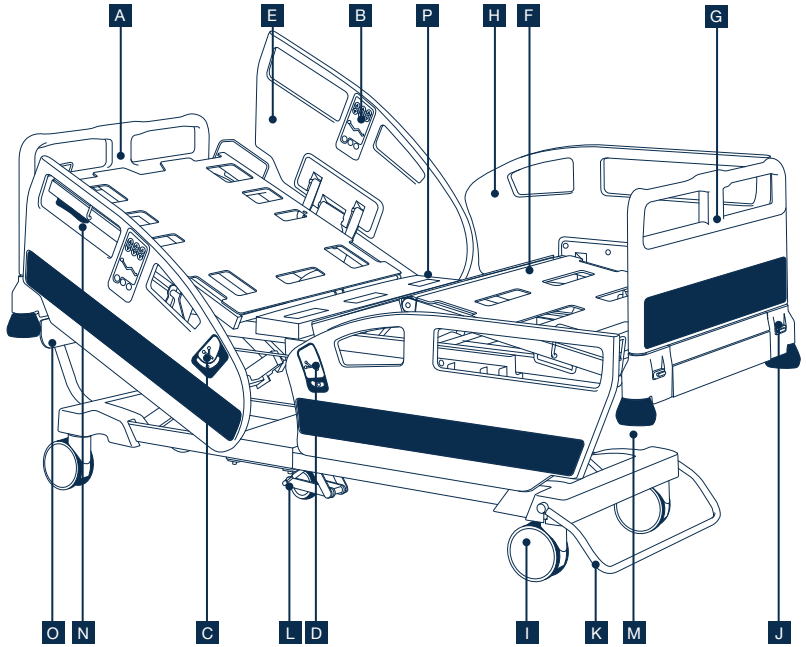

Componentes de la cama

A	Cabecero curvo extraíble	I	Ruedas dobles Ø15 cm
B	Control de membranas en las barandillas	J	Desbloqueo de cabeceros / pieceros
C	Indicador de inclinación respaldo	K	Pedal de frenado
D	Indicador de inclinación Trend / Antitrend	L	Quinta rueda
E	Barandillas de respaldo	M	Discos de protección
F	Lecho de HPL	N	Maneta CPR de emergencia
G	Piecero curvo extraíble	O	Cabecero anclado
H	Barandillas de extremidades	P	Lecho de chapa fijo

www.pardo.es
SERVICIO TÉCNICO
(+34) 976 300 033

ene 2024 | Cód:PCO729751_FichaRapida_NewCare_ES_2020_rev02

Otras funciones

Barandillas (1):

- Elevación: Tirar de la barandilla hacia arriba hasta que quede inmovilizada en su posición más alta.
- Descenso: Tirar del asa que se encuentra debajo de la barandilla hacia afuera. La barandilla bajará automáticamente.

CPR de emergencia (2):

- Accionar cualquiera de las dos palancas situadas debajo del módulo del respaldo, acompañándolo a su vez durante el descenso.

Pedal de freno (3):

- Freno: Pedal en posición baja.
- Giro libre: Pedal en posición horizontal.
- Direccional o 5ª rueda: Pedal en posición elevada.

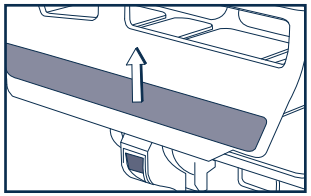

Elevar barandillas

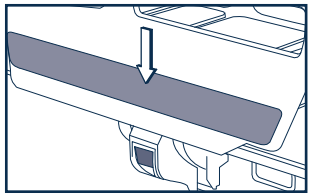

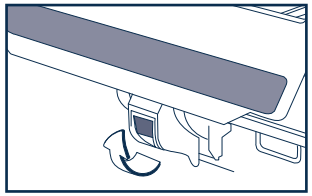

Descender barandillas

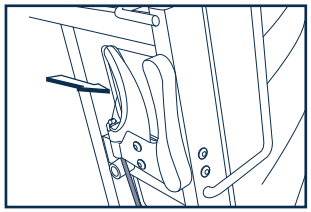

CPR de emergencia



Freno



Movimiento libre



Direccional o 5ª rueda

Limpieza

Limpieza y desinfección diaria con soluciones de cloro con una concentración de hasta 1000 mg/l:

- Barandillas, cabecero, piecero.

Limpieza y desinfección después de la salida de un paciente o antes de un traslado:

- Lecho de la cama, chasis de la cama.

Limpieza y desinfección a fondo cada dos meses:

- Soporte y elevación de la cama.

Mantenimiento

Comprobar siempre el estado correcto de:

- Cableado eléctrico.
- Ruedas.
- Mecanismos de frenado.

Para más información, diríjase al manual de uso y mantenimiento.

Mandos

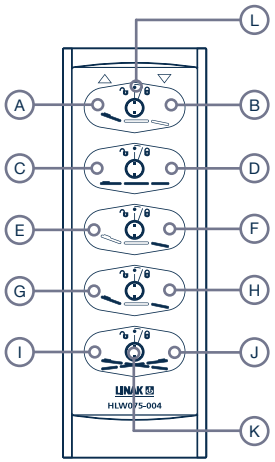

Mando de paciente con bloqueos

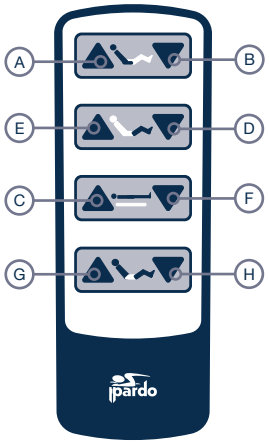

Mando de paciente

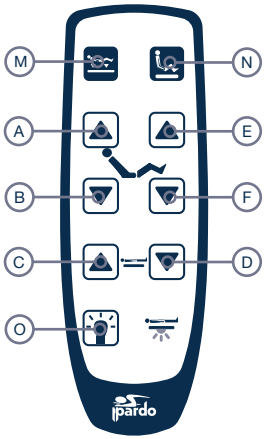

Mando de paciente con luz

Instrucciones de uso

A	Subir respaldo	J	Trendelenburg	T	Led indicador respaldo 30º
B	Bajar respaldo	K	Bloqueo de movimientos	U	Led inidcador Low Position
C	Subir lecho	L	Led indicador de bloqueo de movimientos	V	Seleccionar Trendelenburg / Antitrendelenburg
D	Bajar lecho	M	Posición Flat (bajada simultánea de cuerpos)	W	Indicador de batería
E	Subir piernas	N	Posición Silla Cardíaca	X	Posición Exploración (altura máxima)
F	Bajar piernas	O	Luz bajo cama	Y	Posición Trend de emergencia
G	Subir cuerpos simultáneamente *(autocontour)*	P	CPR de emergencia	Z	Llamada a enfermería
H	Bajar cuerpos simultáneamente *(autocontour)*	Q	Botón Standby		
I	Antitrendelenburg	R	Posición Salida Segura		

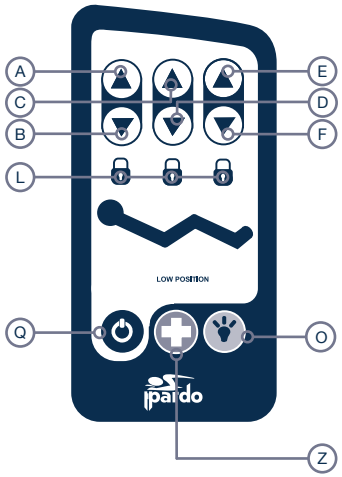

Membranas sin botón de bloqueo

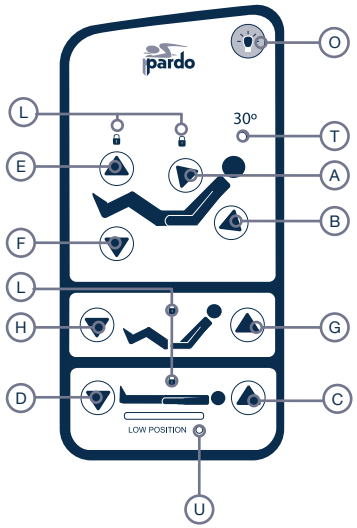

Membranas de paciente

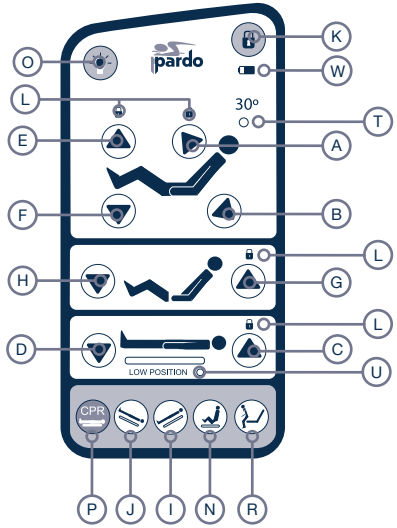

Membranas de enfermería

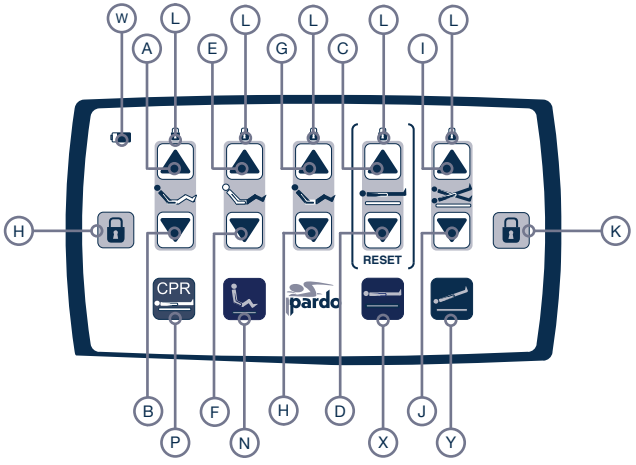

Mando de enfermería por cable

La empresa Industrias Hidráulicas Pardo S.L. cuenta con los siguientes certificados:

IQNET LTD · AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD · AENOR GESTIÓN CALIDAD GESTIÓN DEL SERVICIO SANITARIOS · AENOR GESTIÓN AMBIENTAL · AENOR ECODISEÑO · CE MD

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- En los movimientos de elevación y descenso de las partes móviles del lecho, con el resto de partes de la cama o los accesorios, se deberá comprobar que no se encuentra ningún obstáculo entre estos.
- La duración máxima de la maniobra continua no debe exceder los 2 minutos de lo contrario se pueden causar daños al equipo.
- El movimiento Trendelenburg y Antitrendelenburg debe realizarse siempre bajo supervisión médica.
- Cuando la cama se encuentre en su posición extendida no sentarse ni apoyarse en el extremo de los pies de la cama ya que podría producirse el volcado de la cama.
- No utilizar las manetas del accionamiento bilateral CPR para elevar el respaldo de la cama en ningún caso ya que podría producirse un fallo en el motor de elevación.