Cama NewBabyCare

Ficha de consulta rápida

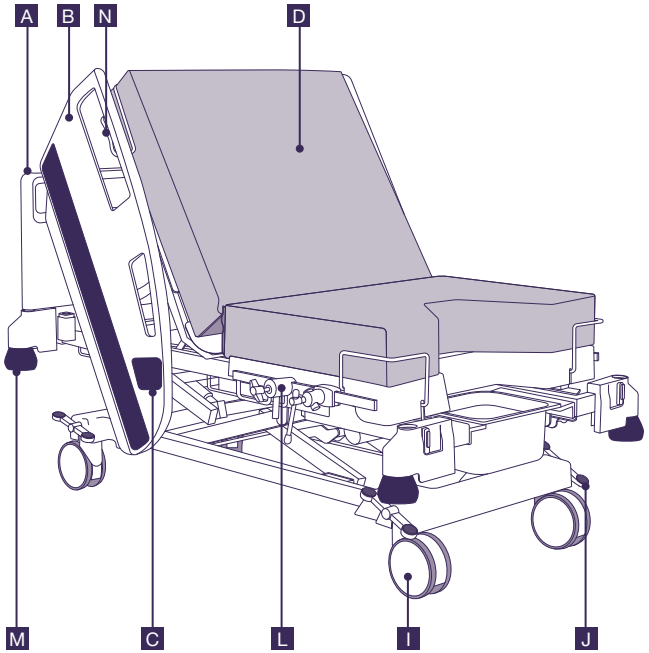

Componentes de la cama

A	Cabecero curvo extraíble	J	Pedal de frenado centralizado
B	Barandillas de respaldo	L	Mordazas para accesorios
C	Indicador de inclinación respaldo	M	Discos de protección
D	Colchón fijo	N	Maneta CPR de emergencia
I	Ruedas dobles Ø15 cm		

Tipología de accesorios ginecológicos

Partos sin epidural - Exigencia mecánica alta (1):
- Extremidades superiores: Arco de agarre o Asideros.
- Extremidades inferiores: Apoyapies en “L”.

Partos con epidural - Exigencia mecánica media (2):
- Extremidades superiores: Arco de agarre o Asideros.
- Extremidades inferiores: Perneras.

Observación - Exigencia mecánica baja (3):
- Extremidades superiores: Asideros.
- Extremidades inferiores: Reposapies.


Marco de agarre


Marco de agarre


Asideros


Asideros


Asideros


Reposapies


Apoyapies “L”

Perneras

Limpieza

Limpieza y desinfección diaria con soluciones de cloro con una concentración de hasta 1000 mg/l:
- Barandillas y cabecero.

Limpieza y desinfección después de la salida de un paciente o antes de un traslado:
- Lecho de la cama, chasis de la cama y cubeta.

Limpieza y desinfección a fondo cada dos meses:
- Soporte y elevación de la cama.

Mantenimiento

Comprobar siempre el estado correcto de:
- Cableado eléctrico.
- Ruedas.
- Mecanismos de frenado.

Para más información, diríjase al manual de uso y mantenimiento.

www.pardo.es
SERVICIO TÉCNICO
(+34) 976 300 033

oct 2023 | CódPCO731116_FichaRapida_NewBabyCare_ES_2020_rev.02

Otras funciones

Barandillas (1):

- Elevación: Tirar de la barandilla hacia arriba hasta que quede inmovilizada en su posición más alta.
- Descenso: Tirar del asa que se encuentra debajo de la barandilla hacia afuera. La barandilla bajará automáticamente.

Pedal de freno (2):

- Freno: Pedal en posición baja.
- Giro libre: Pedal en posición horizontal.
- Direccional: Pedal en posición elevada.

CPR de emergencia (3):

- Accionar cualquiera de las dos palancas situadas debajo del módulo del respaldo, acompañándolo a su vez durante el descenso.

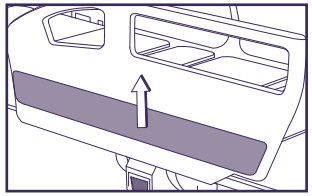

Elevar barandillas

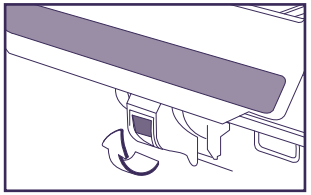

Descender barandillas

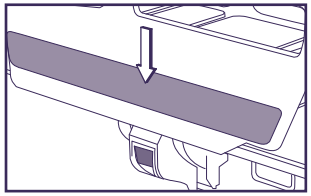

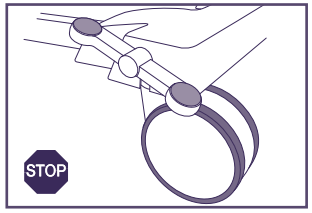

Freno

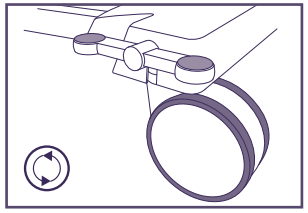

Movimiento libre

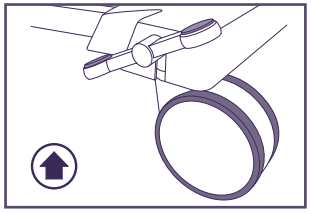

Direccional



CPR de emergencia

Bloqueo y desbloqueo mando paciente

El bloqueo de funciones sirve para inhabilitar las funciones básicas de la cama, sirviendo principalmente para bloquear los movimientos que deben realizarse bajo supervisión médica.

Para bloquear y desbloquear las funciones de la cama, basta con extraer o introducir la llave del mando de bloqueo, sujetada al mando en la parte inferior de éste.

- **Desbloqueo:** Introducir la llave de bloqueo en el lateral del mando. Los leds del mando (L) se pondrán de color verde.
- **Bloqueo**: Sacar la llave de bloqueo del lateral del mando. Los leds del mando (L) se pondrán de color rojo.

Mando

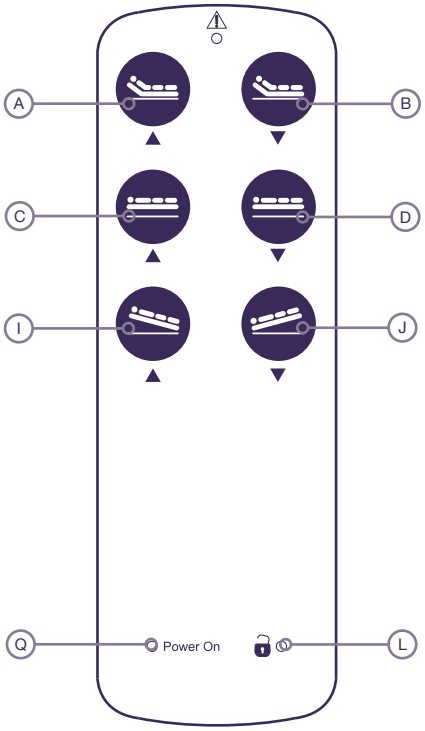

Mando paciente con bloqueos

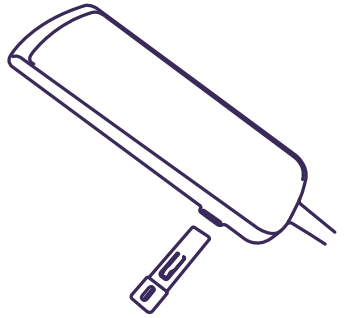

Llave de bloqueo de movimientos

Instrucciones de uso

A	Subir respaldo
B	Bajar respaldo
C	Subir lecho
D	Bajar lecho
I	Antitrend
J	Trend
L	Led indicador de bloqueo de movimientos
Q	Led indicador de funcionamiento

La empresa Industrias Hidráulicas Pardo S.L. cuenta con los siguientes certificados:

IQNET LTD · AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD · AENOR GESTIÓN CALIDAD, SEGURIDAD Y SANITARIOS · AENOR GESTIÓN AMBIENTAL · AENOR ECODISEÑO · CE MD

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- En los movimientos de elevación y descenso de las partes móviles del lecho, con el resto de partes de la cama o los accesorios, se deberá comprobar que no se encuentra ningún obstáculo entre estos.
- La duración máxima de la maniobra continua no debe exceder los 2 minutos de lo contrario se pueden causar daños al equipo.
- El movimiento Trendelenburg y Antitrendelenburg debe realizarse siempre bajo supervisión médica.
- No utilizar las manetas del accionamiento bilateral CPR para elevar el respaldo de la cama en ningún caso ya que podría producirse un fallo en el motor de elevación.

pardo