Cama Alzheimer 19/75

Ficha de consulta rápida

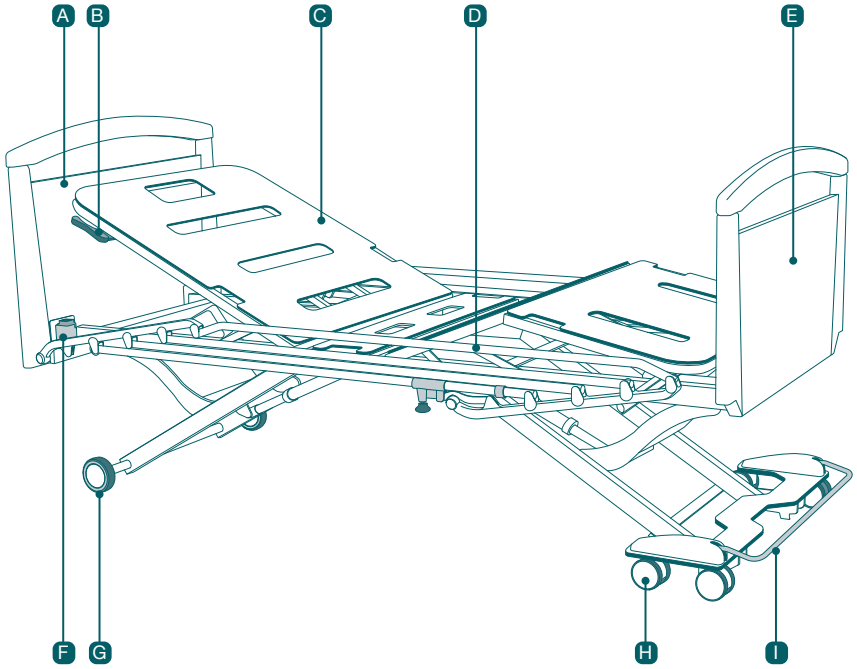

Componentes de la cama

A	Cierre de cabecero atornillado	F	Soporte accesorios
B	Maneta de CPR	G	Rueda fija Ø10 cm
C	Lecho de HPL	H	Ruedas Ø7,5 cm
D	Barandillas de cuatro tubos	I	Pedal de frenado
E	Piecero atornillado		

Barandillas

Barandillas cuatro tubos:

- Elevar barandillas: Tirar de la barandilla hacia el cabecero de la cama hasta que se oiga un “click” de la maneta inferior. La barandilla quedará fijada en su posición más elevada.
- Descender barandillas: Desbloquear la maneta inferior de la barandilla tirando hacia abajo. Plegar la barandilla hacia los pies de la cama acompañándola hasta su posición más baja, donde quedará bloqueada.

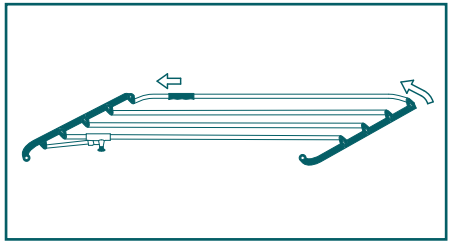

Elevar barandillas

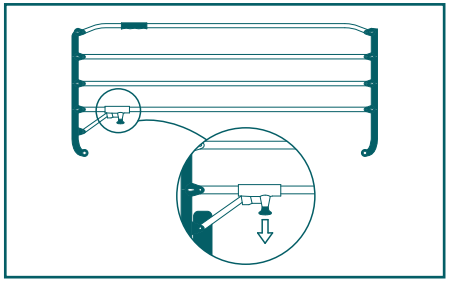

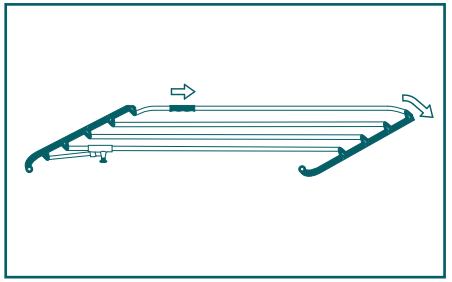

Descender barandillas

Limpieza

Limpieza y desinfección diaria con soluciones de cloro con una concentración de hasta 1000 mg/l:

- Barandillas, cabecero, piecero.

Limpieza y desinfección después de la salida de un paciente o antes de un traslado:

- Lecho de la cama, chasis de la cama, maneta CPR, barandillas, cabecero y piecero.

Limpieza y desinfección a fondo cada dos meses:

- Toda la cama.

Mantenimiento

Comprobar siempre el estado correcto de:

- Cableado eléctrico.
- Ruedas.
- Mecanismos de frenado.

Para más información, diríjase al manual de uso y mantenimiento.

www.pardo.es
SERVICIO TÉCNICO
(+34) 976 300 033

jul 2025 | CódPOO735795_FichaRapida_Alzheimer-1975_ES_2022_rev03

Otras funciones

Pedal multifunción (1):

- Freno: Pedal en posición baja.
- Giro libre: Pedal en posición horizontal.

Lechos HPL (2):

- Lechos fáciles de desmontar debido a que disponen de una pieza que encaja presionándola sobre la estructura de la cama hasta oir un “click”.

CPR de emergencia (3):

- Accionar cualquiera de las dos palancas situadas en la cara inferior del respaldo, acompañándolo a su vez durante el descenso.

Módulo de pies (4):

- Elevar inclinación: Tirar hacia arriba del módulo.
- Descender inclinación: Elevar ligeramente el módulo y bajarlo hasta la posición deseada.





Freno





Movimiento libre



Lechos



Maneta de CPR

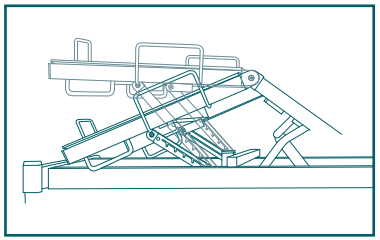

Módulo de pies

Bloqueo y desbloqueo mando paciente

El bloqueo de funciones sirve para inhabilitar las funciones básicas de la cama, sirviendo principalmente para bloquear los movimientos que deben realizarse bajo supervisión médica.

Para bloquear y desbloquear las funciones de la cama, basta con extraer o introducir la llave del mando de bloqueo, sujetada al mando en la parte inferior de éste.

- **Desbloqueo:** Introducir la llave de bloqueo en el lateral del mando. Los leds del mando (L) se pondrán de color verde.
- **Bloqueo:** Sacar la llave de bloqueo del lateral del mando. Los leds del mando (L) se pondrán de color rojo.

Mandos

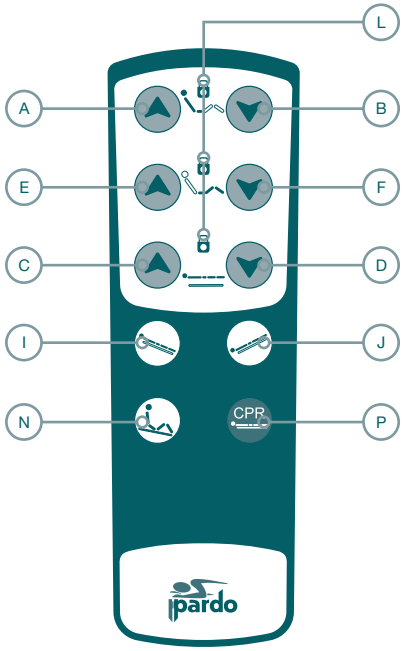

Mando paciente por cable con bloqueos

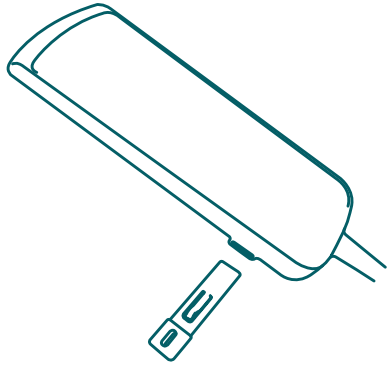

Llave de bloqueo de movimientos

Instrucciones de uso

A	Subir respaldo	I	Posición Antitrendelenburg
B	Bajar respaldo	J	Posición Trendelenburg
C	Subir lecho	L	Indicador led de bloqueo del movimiento
D	Bajar lecho	N	Posición Silla Cardíaca
E	Subir extremidades	P	Posición CPR emergencia
F	Bajar extremidades		

La empresa Industrias Hidráulicas Pardo S.L. cuenta con los siguientes certificados:

IQNET LTD · AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD · AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD, GESTIÓN DEL SERVICIO SANITARIOS · AENOR GESTIÓN AMBIENTAL · AENOR ECODISEÑO · CE MD

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- En los movimientos de elevación y descenso de las partes móviles del lecho, con el resto de partes de la cama o los accesorios, se deberá comprobar que no se encuentra ningún obstáculo entre estos.
- La duración máxima de la maniobra continua no debe exceder los 2 minutos de lo contrario se pueden causar daños al equipo.
- El movimiento Trendelenburg y Antitrendelenburg debe realizarse siempre bajo supervisión médica.
- No utilizar las manetas del accionamiento bilateral CPR para elevar el respaldo de la cama en ningún caso ya que podría producirse un fallo en el motor de elevación.

pardo

Industrias Hidráulicas Pardo, S.L. C/ Los Ángeles 5, (Polígono Centrovía) - 50198 La Muela, Zaragoza (Spain)