Cama Bora Med

Ficha de consulta rápida

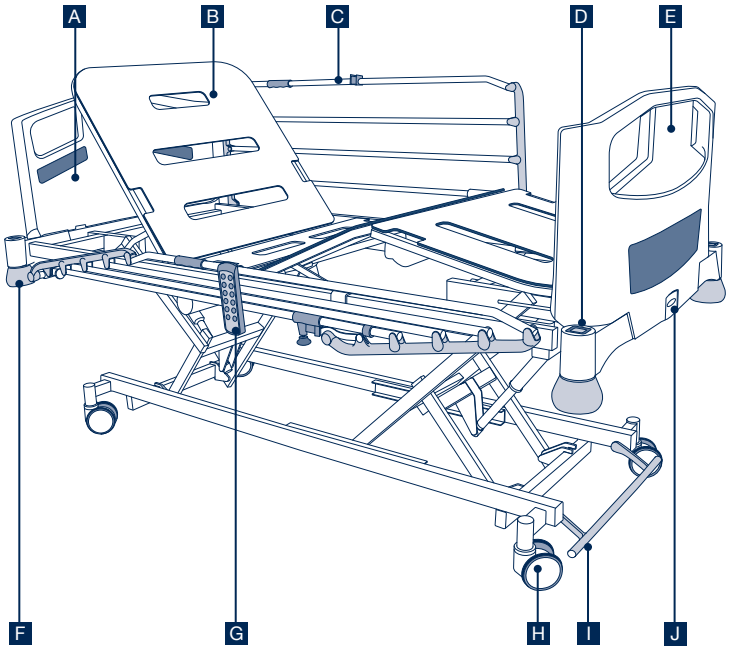

Componentes de la cama

A	Cabecero extraíble	F	Discos de protección
B	Lecho de HPL	G	Mando por cable
C	Barandillas de tubos	H	Ruedas dobles carenadas Ø10 cm
D	Soporte accesorios	I	Pedal de frenado centralizado
E	Piecero extraíble	J	Desbloqueo de cabeceros y pieceros

mar 2026 | Cód:PCO748308_FichaRapida_BoraMed_ES_2020_rev03

www.pardo.es
SERVICIO TÉCNICO
(+34) 976 300 033

Barandillas

Barandillas de tubos:

- Elevar barandillas: Tirar de la barandilla hacia el cabecero de la cama (1) hasta que se oiga un "click" de la maneta inferior (2). La barandilla quedará fijada en su posición más elevada.
- Descender barandillas: Desbloquear la maneta inferior de la barandilla (3) tirando hacia abajo. Plegar la barandilla hacia los pies de la cama (4) acompañándola hasta su posición más baja donde quedará bloqueada.



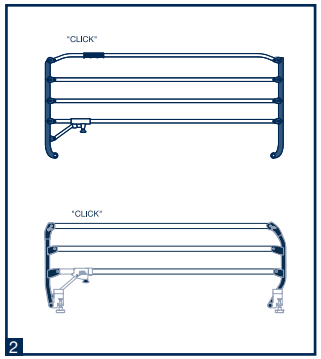

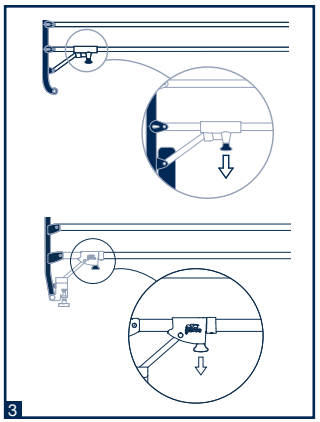



Limpieza

Limpieza y desinfección diaria con soluciones de cloro con una concentración de hasta 1000 mg/l:

- Barandillas, cabecero, piecero.

Limpieza y desinfección después de la salida de un paciente o antes de un traslado:

- Lecho de la cama, chasis de la cama.

Limpieza y desinfección a fondo cada dos meses:

- Soporte y elevación de la cama.

Mantenimiento

Comprobar siempre el estado correcto de:

- Cableado eléctrico.
- Ruedas.
- Mecanismos de frenado.

Para más información, diríjase al manual de uso y mantenimiento.

Otras funciones

Pedal de freno (1):

- Freno: Pedal en posición baja.
- Giro libre: Pedal en posición horizontal.
- Direccional: Pedal en posición elevada

CPR de emergencia (2):

- Accionar cualquiera de las dos palancas situadas en el centro de la cama, acompañándolo a su vez durante el descenso.

Lecho extensible (3):

- Tirar y girar de los tiradores hacia arriba desbloqueando así el sistema de anclaje.
- Tirar del piecero hasta extender completamente.
- Empujar el piecero hasta escuchar “click”.



Freno



Movimiento libre



Direccional

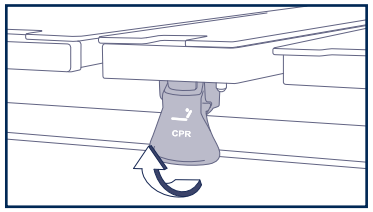

CPR de emergencia







Extraer el extensible del somier

Mandos

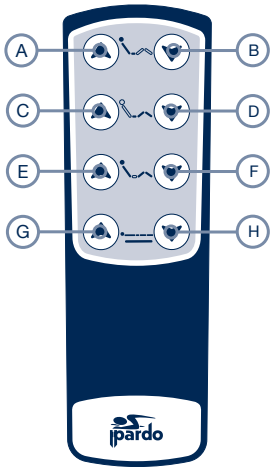

Mando de paciente

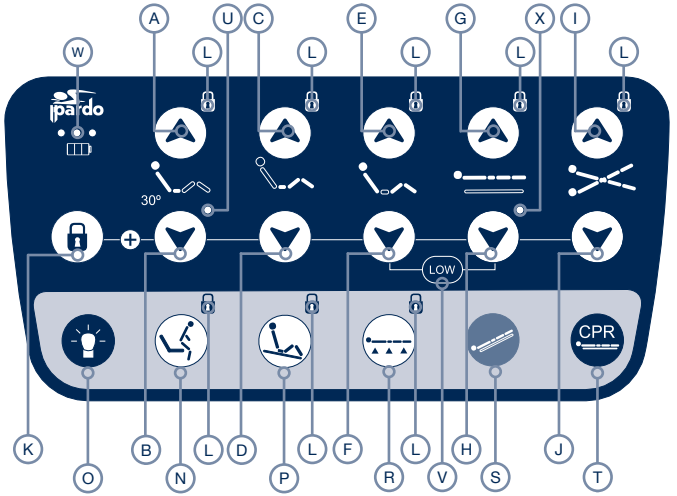

Mando de enfermería

Instrucciones de uso

A	Subir respaldo	L	Led de bloqueo de movimientos
B	Bajar respaldo	N	Posición Salida Segura
C	Subir extremidades	O	Luz bajo cama (2)
D	Bajar extremidades	P	Posición Silla cardíaca
E	Subir cuerpos simultáneamente *(autocontour)*	R	Posición exploración (altura máxima)
F	Bajar cuerpos simultáneamente *(autocontour)*	S	Posición Trend de emergencia
G	Subir lecho	T	CPR de emergencia
H	Bajar lecho	U	Led respaldo 30º
I	Antitrend	V	Posición más baja (1)
J	Trend	W	Indicador de batería
K	Bloqueo de movimientos	X	Indicador posición más baja

(1) Pulsar simultáneamente F+H, cuando la cama esté en la altura mínima.

(2) Sólo en caso de que la cama lo incorpore.

La empresa Industrias Hidráulicas Pardo S.L. cuenta con los siguientes certificados:

IQNET LTD · AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD · AENOR GESTIÓN CALIDAD GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SANIDAD · AENOR GESTIÓN AMBIENTAL · AENOR ECODISEÑO · CE MD

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- En los movimientos de elevación y descenso de las partes móviles del lecho, con el resto de partes de la cama o los accesorios, se deberá comprobar que no se encuentra ningún obstáculo entre estos.
- La duración máxima de la maniobra continua no debe exceder los 2 minutos de lo contrario se pueden causar daños al equipo.
- El movimiento Trendelenburg y Antitrendelenburg debe realizarse siempre bajo supervisión médica.
- Cuando la cama se encuentre en su posición extendida no sentarse ni apoyarse en el extremo de los pies de la cama ya que podría producirse el volcado de la cama.
- No utilizar las manetas del accionamiento bilateral CPR para elevar el respaldo de la cama en ningún caso ya que podría producirse un fallo en el motor de elevación.

Industrias Hidráulicas Pardo, S.L. C/ Los Ángeles 5, (Polígono Centrovía) - 50198 La Muela, Zaragoza (Spain)