Cama NewCare V3 ACT

Ficha de consulta rápida

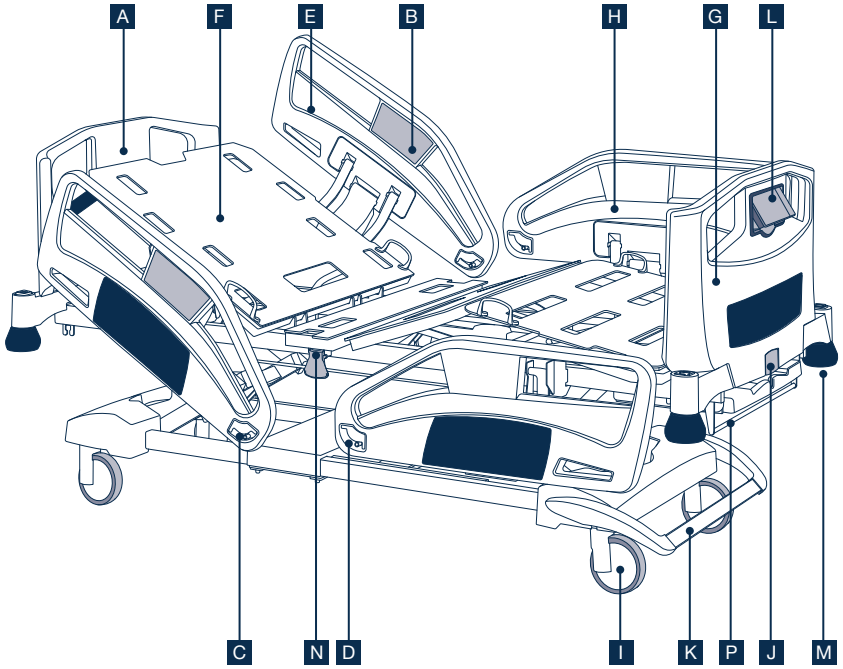

Componentes de la cama

A	Cabecero extraíble	I	Ruedas integrales Ø15 cm
B	Control de membranas en las barandillas	J	Desbloqueo de cabeceros y pieceros
C	Indicador de inclinación respaldo	K	Pedal de frenado
D	Indicador de inclinación Trend y Antitrend	L	Pantalla táctil
E	Barandillas de respaldo	M	Discos de protección
F	Lecho de HPL	N	Maneta CPR de emergencia
G	Piecero extraíble	P	Extensible de la cama
H	Barandillas de extremidades		

www.pardo.es
SERVICIO TÉCNICO
(+34) 976 300 033

Otras funciones

Barandillas (1):

- Elevación: Tirar de la barandilla hacia arriba hasta que quede inmovilizada en su posición más alta.
- Descenso: Tirar del asa que se encuentra debajo de la barandilla hacia afuera. La barandilla bajará automáticamente.

CPR de emergencia (2):

- Accionar cualquiera de las dos palancas situadas en el centro de la cama, acompañándolo a su vez durante el descenso.

Pedal de freno (3):

- Freno: Pedal en posición baja.
- Giro libre: Pedal en posición horizontal.
- Direccional: Pedal en posición elevada.

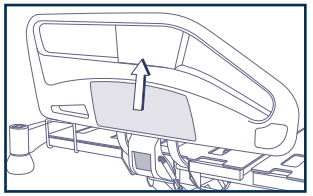
Elevar barandillas

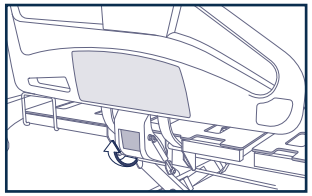
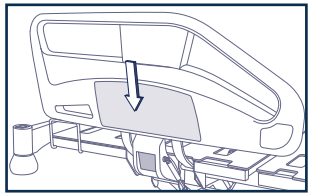
Descender barandillas

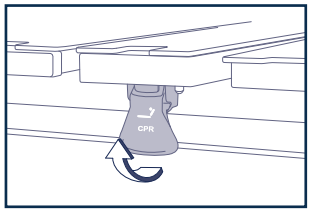

CPR de emergencia



Freno


Movimiento libre


Direccional

Limpieza

Limpieza y desinfección diaria con soluciones de cloro con una concentración de hasta 1000 mg/l:

- Barandillas, cabecero, piecero.

Limpieza y desinfección después de la salida de un paciente o antes de un traslado:

- Lecho de la cama, chasis de la cama.

Limpieza y desinfección a fondo cada dos meses:

- Soporte y elevación de la cama.

Mantenimiento

Comprobar siempre el estado correcto de:

- Cableado eléctrico.
- Ruedas.
- Mecanismos de frenado.

Para más información, diríjase al manual de uso y mantenimiento.

oct 2023 | CódPOO748852_FichaRapida_NewCareV3ACT_ES_2020_rev02

INSTRUCCIONES DE USO PANTALLA

1	Selección pantalla (movimientos básicos)
2	Selección de opciones (pesaje)
3	Selección de ajustes
A	Subir respaldo
B	Bajar respaldo
E	Subir extremidades
F	Bajar extremidades
I	Botón subir
J	Botón bajar
K	Bloqueo de movimientos
N	Posición silla cardíaca
P	CPR de emergencia
Q	Botón ON (activación de las pantalla)
R	Seleccionar elevación del lecho
S	Seleccionar cuerpos simultáneamente
V	Seleccionar Trend / Antitrend
X	Posición exploración (altura máxima)

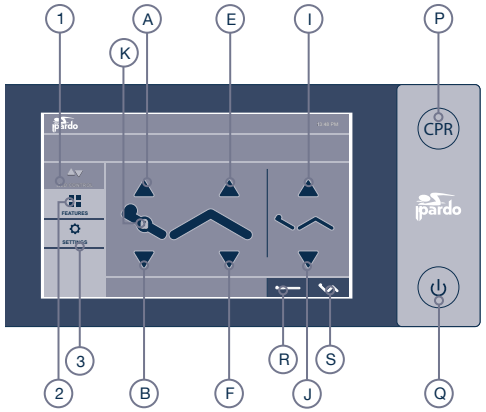

Pantalla táctil - Menú básico

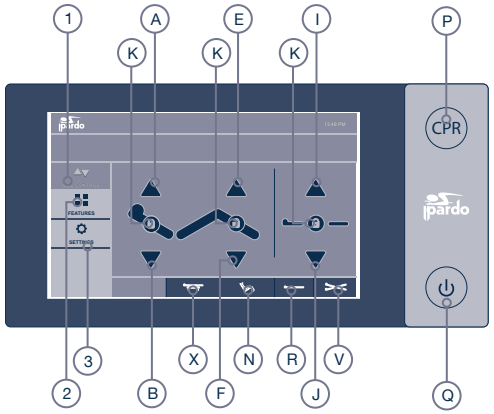

Pantalla táctil - Menú enfermería

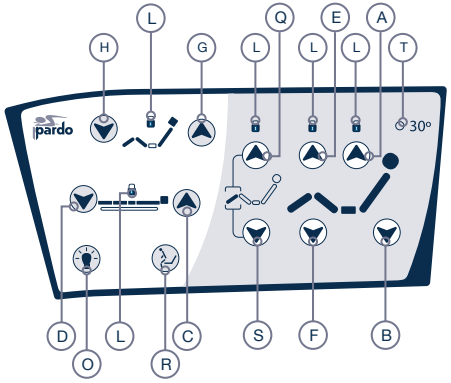

Mando enfermería para pies motorizados

INSTRUCCIONES DE USO MEMBRANAS

A	Subir respaldo	K	Bloqueo de movimientos
B	Bajar respaldo	L	Indicador de bloqueo de movimientos
C	Subir lecho	N	Posición silla cardíaca
D	Bajar lecho	O	Luz bajo cama
E	Subir extremidades	P	CPR de emergencia
F	Bajar extremidades	R	Posición Salida Segura
G	Subir cuerpos simultáneamente *(autocontour)*	T	Indicador Led de 30º
H	Bajar cuerpos simultáneamente *(autocontour)*	U	Indicador Led posición baja
I	Antitrend	Q	Elevación tramo pies
J	Trend	S	Descenso tramo pies

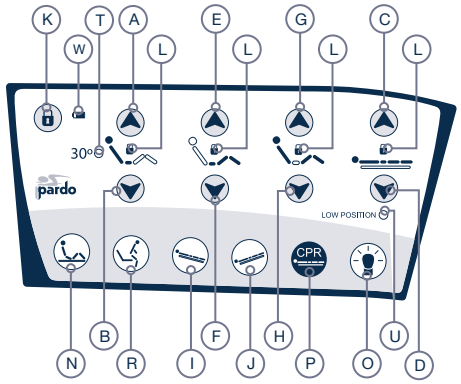

Membrana de enfermería con bloqueos

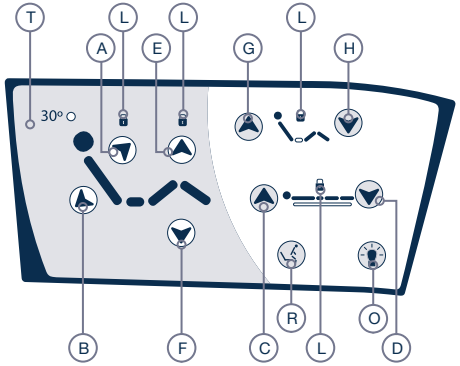

Membrana de paciente con bloqueos

La empresa Industrias Hidráulicas Pardo S.L. cuenta con los siguientes certificados:

IQNET LTD · AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD · AENOR GESTIÓN CALIDAD, GESTIÓN DEL SANITARIOS · AENOR GESTIÓN AMBIENTAL · AENOR ECODISEÑO · CE MD

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- En los movimientos de elevación y descenso de las partes móviles del lecho, con el resto de partes de la cama o los accesorios, se deberá comprobar que no se encuentra ningún obstáculo entre estos.
- La duración máxima de la maniobra continua no debe exceder los 2 minutos de lo contrario se pueden causar daños al equipo.
- El movimiento Trendelenburg y Antitrendelenburg debe realizarse siempre bajo supervisión médica.
- Cuando la cama se encuentre en su posición extendida no sentarse ni apoyarse en el extremo de los pies de la cama ya que podría producirse el volcado de la cama.
- No utilizar las manetas del accionamiento bilateral CPR para elevar el respaldo de la cama en ningún caso ya que podría producirse un fallo en el motor de elevación.