Cama Classic Evo

Ficha de consulta rápida

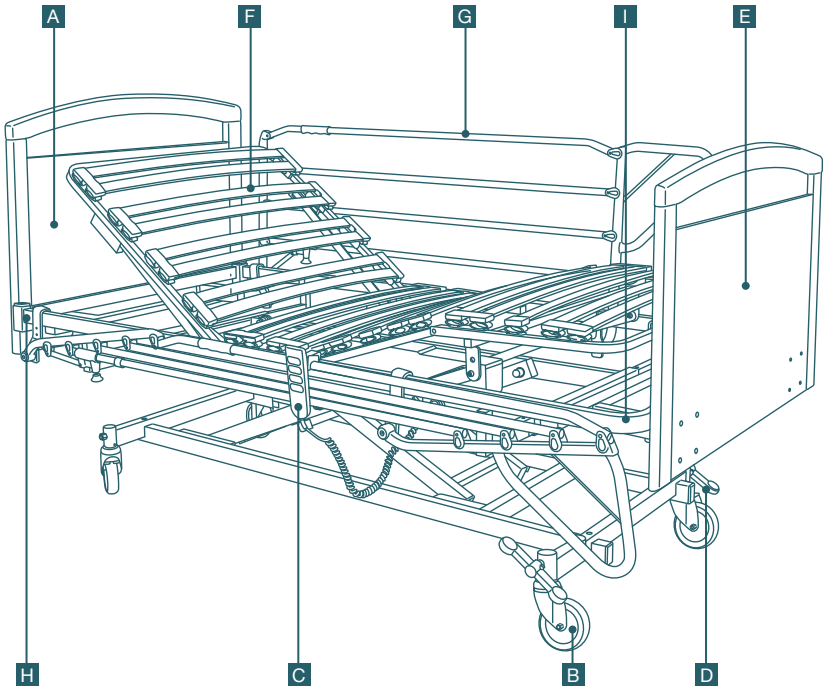

Componentes de la cama

A	Cierre de cabecero atornillado	F	Lecho de lamas dobles de madera
B	Ruedas de chapa Ø12,5 cm.	G	Barandillas de tubos
C	Mando por cable	H	Soporte accesorios
D	Pedal de freno centralizado	I	Somier redondeado en zona piecero
E	Piecero atornillado		

Barandillas

Barandillas de tubos:

- **Elevar barandillas:** Tirar de la barandilla hacia el cabecero de la cama (1) hasta que se oiga un “click” de la maneta inferior (2). La barandilla quedará fijada en su posición más elevada.

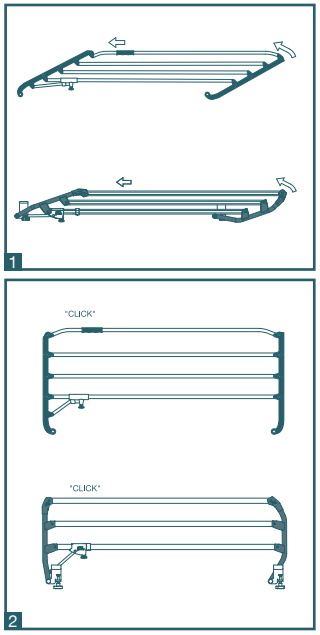

- **Descender barandillas:** Desbloquear la maneta inferior de la barandilla (3) tirando hacia abajo. Plegar la barandilla hacia los pies de la cama (4) hasta su posición más baja, donde quedará bloqueada.

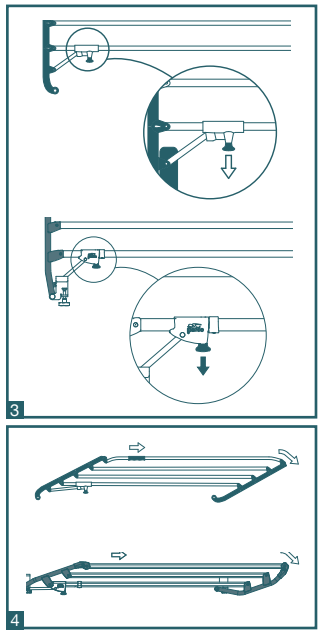

Limpieza

Limpieza y desinfección diaria con soluciones de cloro con una concentración de hasta 1000 mg/l:

- Barandillas, cabecero, piecero.

Limpieza y desinfección después de la salida de un paciente o antes de un traslado:

- Lecho de la cama, chasis de la cama.

Limpieza y desinfección a fondo cada dos meses:

- Soporte y elevación de la cama.

Mantenimiento

Comprobar siempre el estado correcto de:

- Cableado eléctrico.
- Ruedas.
- Mecanismos de frenado.

Para más información, diríjase al manual de uso y mantenimiento.

www.pardo.es
SERVICIO TÉCNICO
(+34) 976 300 033

feb 2026 | CódPCO752794_FichaRapida_ClassicEvo_ES_2022_rev02

Otras funciones

Pedal de freno (1):

- Freno: Pedal en posición baja.
- Giro libre: Pedal en posición horizontal.
- Direccional: Pedal en posición elevada.

Gama de lechos (2):

- Lechos de lamas dobles de madera formado por cuatro cuerpos.
- Lecho ABS ergonómico dividido en 4 secciones y realizado en plástico sanitario.



Freno



Movimiento libre



Rueda direccional

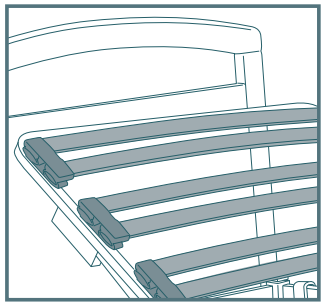

Lecho lamas dobles de madera

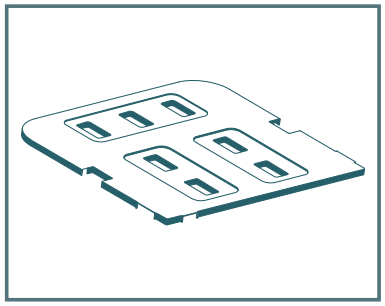

Lecho ABS

Mandos

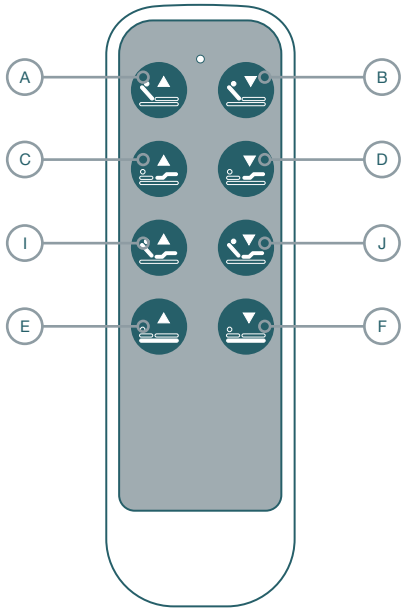

Mando por cable para cama con carro

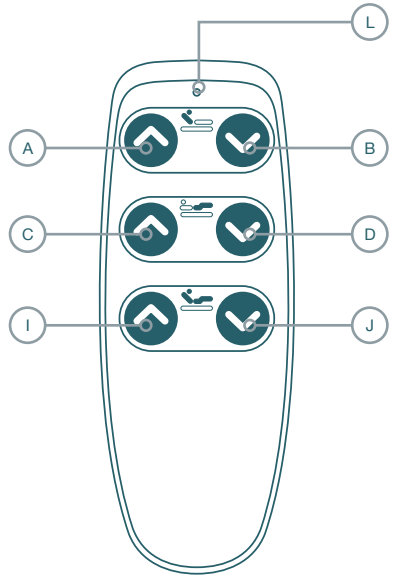

Mando por cable para cama con patas

Instrucciones de uso

A	Subir respaldo	F	Bajar lecho
B	Bajar respaldo	I	Subir respaldo y extremidades simultánemente (autocontour)
C	Subir extremidades	J	Bajar respaldo y extremidades simultánemente (autocontour)
D	Bajar extremidades	L	Indicador Led de movimiento
E	Subir lecho		

La empresa Industrias Hidráulicas Pardo S.L. cuenta con los siguientes certificados:

IQNET LTD · AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD · AENOR GESTIÓN CALIDAD GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SANITARIOS · AENOR GESTIÓN AMBIENTAL · AENOR ECODISEÑO · CE MD

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- En los movimientos de elevación y descenso de las partes móviles del lecho, con el resto de partes de la cama o los accesorios, se deberá comprobar que no se encuentra ningún obstáculo entre estos.
- La duración máxima de la maniobra continua no debe exceder los 2 minutos de lo contrario se pueden causar daños al equipo.
- El movimiento Trendelenburg y Antitrendelenburg debe realizarse siempre bajo supervisión médica.
- Cuando la cama se encuentre en su posición extendida no sentarse ni apoyarse en el extremo de los pies de la cama ya que podría producirse el volcado de la cama.
- No utilizar las manetas del accionamiento bilateral CPR para elevar el respaldo de la cama en ningún caso ya que podría producirse un fallo en el motor de elevación.

pardo