Cama TechnoPlus i10 ICU

Ficha de consulta rápida

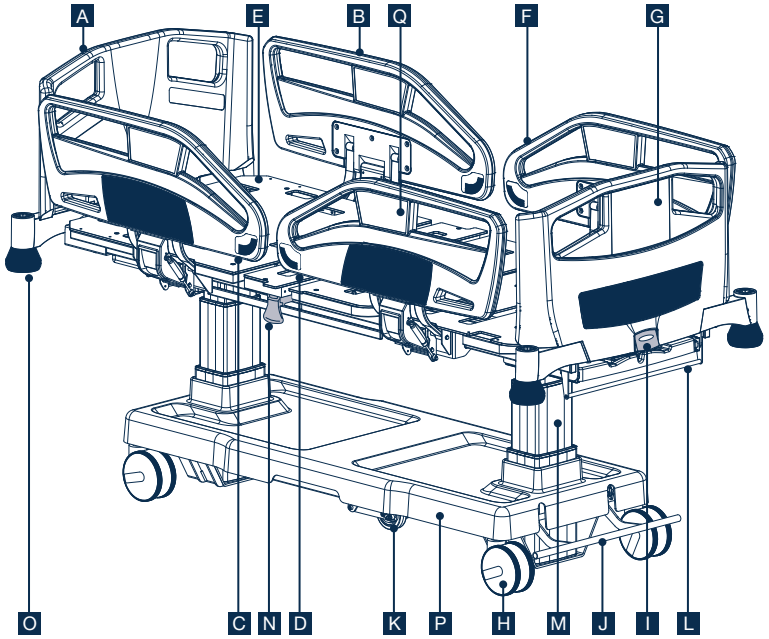

Componentes de la cama

A	Cabecero extraíble	J	Pedal de frenado
B	Barandillas de respaldo	K	Quinta rueda
C	Indicador de inclinación respaldo	L	Palanca del extensible de la cama
D	Indicador de inclinación Trendelenburg y Antitrendelenburg	M	Columnas de elevación
E	Lechos de HPL	N	Maneta CPR de emergencia
F	Barandillas de extremidades	O	Discos de protección
G	Piecero extraíble	P	Carenado inferior
H	Ruedas Ø15 cm	Q	Sistema de pesaje en barandillas
I	Desbloqueo de cabeceros y pieceros		

Otras funciones

Barandillas:

- Elevación: Tirar de la barandilla hacia arriba hasta que quede inmovilizada en su posición más alta (1).
- Descenso: Tirar del asa que se encuentra debajo de la barandilla hacia afuera (2). La barandilla bajará automáticamente (3).

CPR de emergencia:

- Accionar cualquiera de las dos palancas situadas en el centro de la cama, acompañándolo a su vez durante el descenso (4).

Pedal de freno:

- Freno: Pedal en posición baja (5).
- Giro libre: Pedal en posición horizontal (6).
- Direccional o 5ª rueda: Pedal en posición elevada (7).

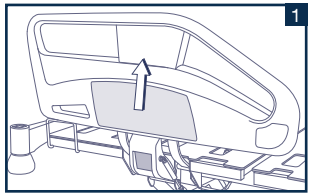

Elevar barandillas

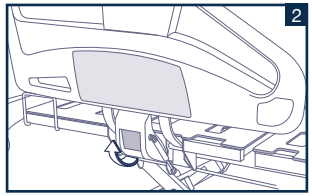

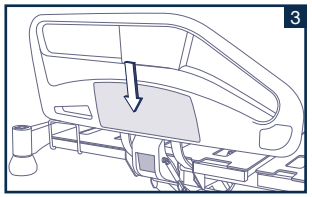

Descender barandillas

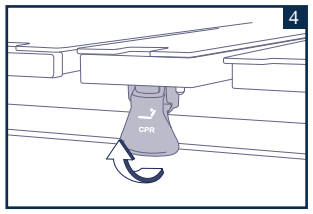

CPR de emergencia



Freno



Movimiento libre



Direccional o 5ª rueda

Limpieza

Limpieza y desinfección diaria con soluciones de cloro con una concentración de hasta 1000 mg/l:

- Barandillas, cabecero, piecero.

Limpieza y desinfección después de la salida de un paciente o antes de un traslado:

- Lecho de la cama, chasis de la cama.

Limpieza y desinfección a fondo cada dos meses:

- Toda la cama.

Mantenimiento

Comprobar siempre el estado correcto de:

- Cableado eléctrico.
- Ruedas.
- Mecanismos de frenado.

Para más información, diríjase al manual de uso y mantenimiento.

www.pardo.es
SERVICIO TÉCNICO
(+34) 976 300 033

jul 2024 | CódPCO753447_FichaRapida_TechnoPlus_i10_ICU_ES_2024

Mandos

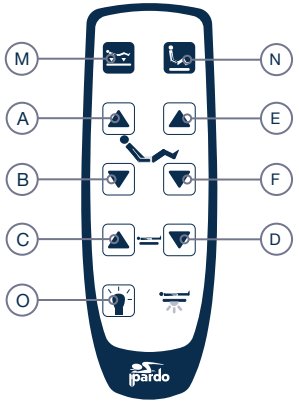

Mando de paciente con luz

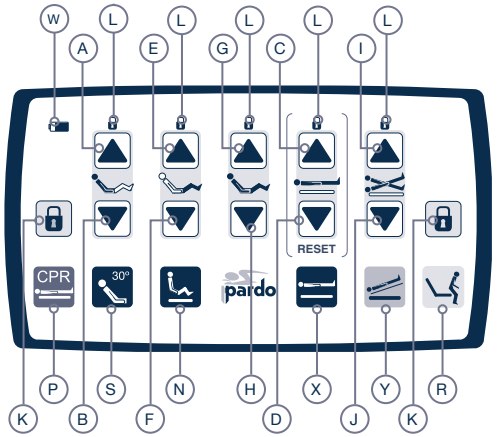

Mando de enfermería por cable ACO

Instrucciones de uso

A	Subir respaldo	S	Posición respaldo 30º
B	Bajar respaldo	T	Led indicador respaldo 30º
C	Subir lecho	U	Led indicador posición más baja
D	Bajar lecho	W	Indicador de batería
E	Subir piernas	X	Posición exploración (altura máxima)
F	Bajar piernas	Y	Posición Trend de emergencia
G	Subir cuerpos simultáneamente *(autocontour)*	1	Pantalla de 4 dígitos
H	Bajar cuerpos simultáneamente *(autocontour)*	2	Botón “Menú”
I	Antitrendelenburg	3	Botón de confirmación/selección
J	Trendelenburg	4	4 botones de navegación
K	Bloqueo de movimientos	5	Botón “ON / OFF”
L	Led indicador de bloqueo de movimientos	6	Botón Memoria
N	Posición silla cardíaca	7	Botón Puesta a cero
O	Luz bajo cama	8	Botón Auto-compensación
P	CPR de emergencia	9	Botón Resolución
R	Posición Salida Segura		

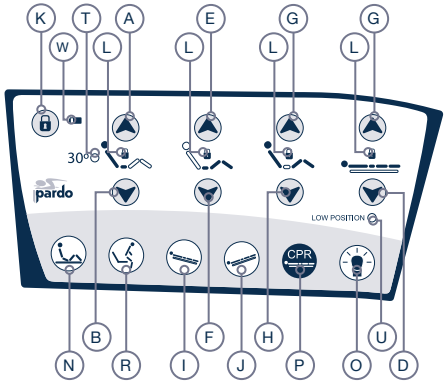

Membrana de enfermería con bloqueos

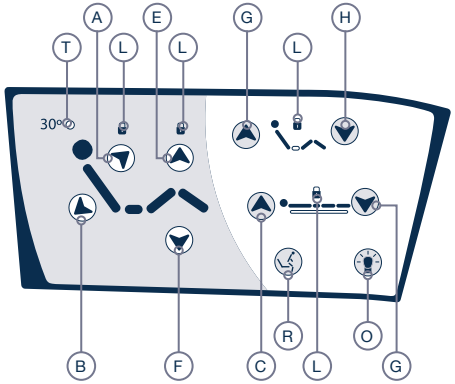

Membrana de paciente con bloqueos

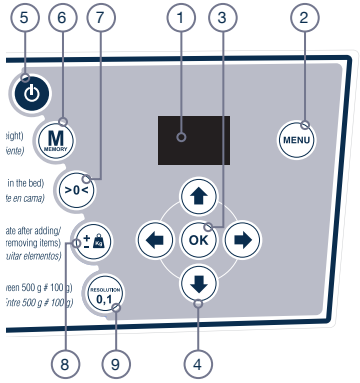

Sistema de pesaje

La empresa Industrias Hidráulicas Pardo S.L. cuenta con los siguientes certificados:

IQNET LTD · AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD · AENOR GESTIÓN CALIDAD GESTIÓN DEL SANEAMIENTO · AENOR GESTIÓN AMBIENTAL · AENOR ECODISEÑO · CE MD

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- En los movimientos de elevación y descenso de las partes móviles del lecho, con el resto de partes de la cama o los accesorios, se deberá comprobar que no se encuentra ningún obstáculo entre estos.
- La duración máxima de la maniobra continua no debe exceder los 2 minutos de lo contrario se pueden causar daños al equipo.
- El movimiento Trendelenburg y Antitrendelenburg debe realizarse siempre bajo supervisión médica.
- Cuando la cama se encuentre en su posición extendida no sentarse ni apoyarse en el extremo de los pies de la cama ya que podría producirse el volcado de la cama.
- No utilizar las manetas del accionamiento bilateral CPR para elevar el respaldo de la cama en ningún caso ya que podría producirse un fallo en el motor de elevación.