Cama NewCare PSYC

Ficha de consulta rápida

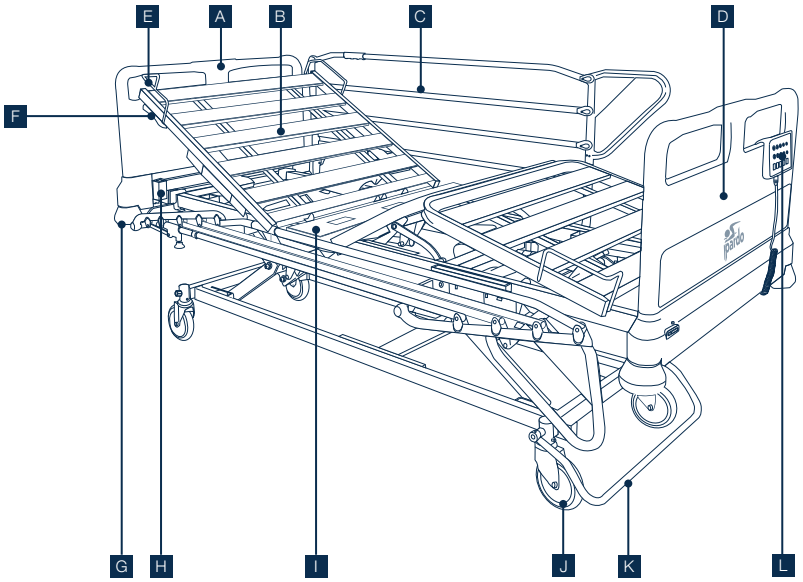

Componentes de la cama

A	Cabecero	G	Discos de protección
B	Lecho de lamas metálicas	H	Soporte accesorios
C	Barandillas de cuatro tubos	I	Lecho de chapa fijo
D	Piecero	J	Ruedas metálicas Ø15 cm
E	Arquillos retenedores	K	Pedal de freno centralizado
F	Maneta CPR de emergencia	L	Mando por cable

Otras funciones

Barandillas cuatro tubos:

- Elevar barandillas: Tirar de la barandilla hacia el cabecero de la cama hasta que se oiga un “click” de la maneta inferior.
- Descender barandillas: Desbloquear la maneta inferior de la barandilla tirando de ella hacia abajo. Plegar la barandilla hacia los pies de la cama acompañándola hasta su posición más baja donde quede bloqueada.





Elevar barandillas





Descender barandillas

Sistema de frenado:

- Freno: Barra/pedal en posición baja.
- Giro libre: Barra/pedal en posición horizontal.
- Direccional: Barra/pedal en posición elevada.







Barra de freno

Pedales de freno

Limpieza

Limpieza y desinfección diaria con soluciones de cloro con una concentración de hasta 1000 mg/l:

- Barandillas, cabecero, piecero.

Limpieza y desinfección después de la salida de un paciente o antes de un traslado:

- Lecho de la cama, chasis de la cama.

Limpieza y desinfección a fondo cada dos meses:

- Toda la cama.

Mantenimiento

Comprobar siempre el estado correcto de:

- Cableado eléctrico.
- Ruedas.
- Mecanismos de frenado.

Para más información, diríjase al manual de uso y mantenimiento.

www.pardo.es
SERVICIO TÉCNICO
(+34) 976 300 033

ago 2024 | Cód:PCO701629_FichaRapida_NewCarePSYC_ES_2024

Mandos

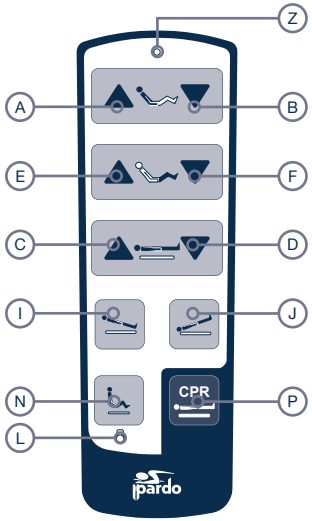

Mando de paciente con bloqueos

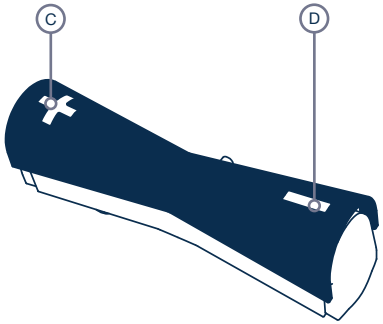

Pedal de elevación

Instrucciones de uso

A	Subir respaldo	J	Trendelenburg
B	Bajar respaldo	K	Bloqueo de movimientos
C	Subir lecho	L	Led indicador de bloqueo de movimientos
D	Bajar lecho	N	Posición Silla Cardíaca
E	Subir piernas	P	CPR de emergencia
F	Bajar piernas	W	Indicador de batería
G	Subir respaldo y piernas simultáneamente *(autocontour)*	X	Posición exploración (altura máxima)
H	Bajar respaldo y piernas simultáneamente *(autocontour)*	Y	Posición Trend de emergencia
I	Antitrendelenburg	Z	Led indicador de funcionamiento

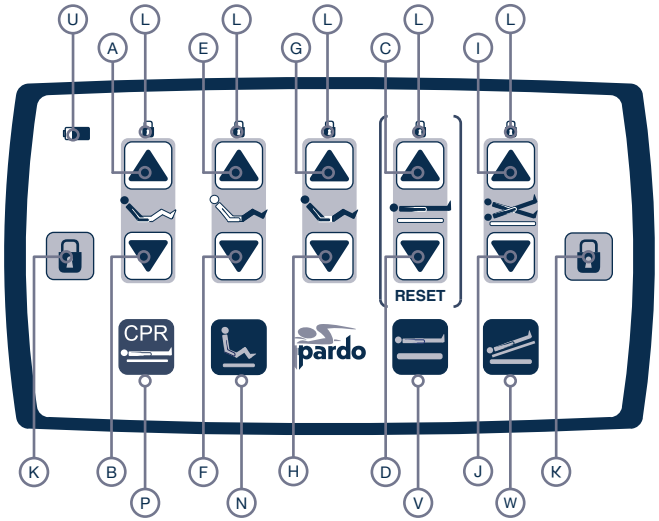

Mando de enfermería por cable ACO

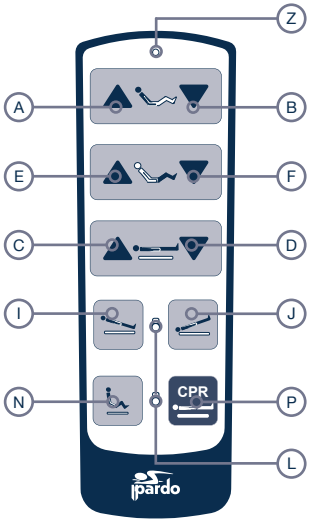

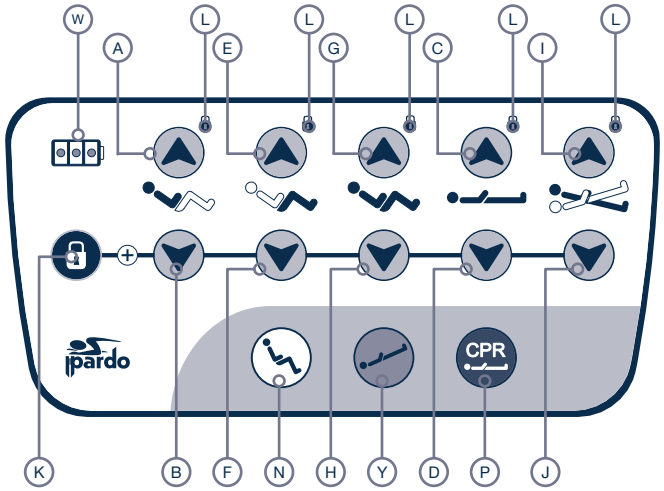

Mando de paciente y enfermería con bloqueos versión Timotion

La empresa Industrias Hidráulicas Pardo S.L. cuenta con los siguientes certificados:

IQNET LTD · AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD · AENOR GESTIÓN CALIDAD GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO · AENOR GESTIÓN AMBIENTAL · AENOR ECODISEÑO · CE MD

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- En los movimientos de elevación y descenso de las partes móviles del lecho, con el resto de partes de la cama o los accesorios, se deberá comprobar que no se encuentra ningún obstáculo entre estos.
- La duración máxima de la maniobra continua no debe exceder los 2 minutos de lo contrario se pueden causar daños al equipo.
- El movimiento Trendelenburg y Antitrendelenburg debe realizarse siempre bajo supervisión médica.
- No utilizar las manetas del accionamiento bilateral CPR para elevar el respaldo de la cama en ningún caso ya que podría producirse un fallo en el motor de elevación.