Camilla Atica3404

Ficha de consulta rápida

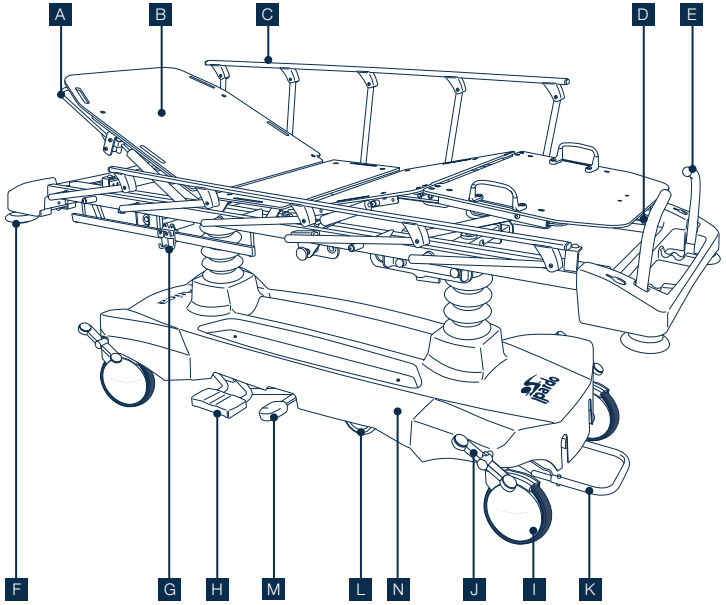

Componentes de la camilla

A	Palanca accionamiento respaldo	H	Pedal de posicionamiento triple
B	Lechos de HPL*	I	Ruedas Ø20 cm
C	Barandillas plegables	J	Pedal de frenado centralizado
D	Palanca accionamiento extremidades	K	Pedal accionamiento quinta rueda
E	Asas de traslado	L	Quinta rueda
F	Discos de protección	M	Pedal elevación del lecho
G	Ganchos portadrenajes	N	Carenado inferior

*Dos o cuatro planos articulados según modelo.

www.pardo.es
SERVICIO TÉCNICO
(+34) 976 300 033

ene 2025 | Cód:PCO753133_FichaRapida_Atica3404_ES_2022_rev01

Otras funciones

Barandillas plegables (1):

- Elevación: Tirar de la barandilla hacia arriba hasta que quede inmoviliza da en su posición más alta.
- Descenso: Tirar del asa que se encuentra debajo de la barandilla hacia afuera. La barandilla bajará automáticamente.

Pedal de freno (2):

- Freno: Pedal en posición baja.
- Movimiento libre: Pedal en posición horizontal.
- Direccional: Pedal en posición elevada.

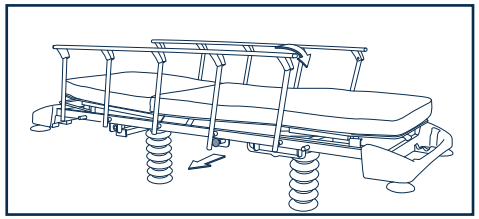

Descender barandillas

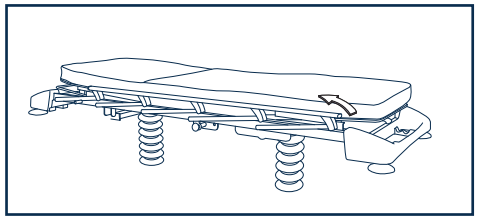

Elevar barandillas



Freno



Movimiento libre



Direccional

Limpieza

Limpieza y desinfección diaria con soluciones de cloro con una concentración de hasta 1000 mg/l:

- Barandillas y asas abatibles.

Limpieza y desinfección después de la salida de un paciente o antes de un traslado:

- Lechos, carenados, discos protectores, palancas y varillas para drenajes.

Limpieza y desinfección a fondo cada dos meses:

- Toda la camilla.

Mantenimiento

Comprobar siempre el estado correcto de:

- Ruedas.
- Mecanismos de frenado.
- Componentes mecánicos de accionamiento de cuerpos y lechos.

Para más información, diríjase al manual de uso y mantenimiento.

Funcionamiento mecánico

Elevación / descenso de la camilla (1):

- Subida: Pisar repetidamente el pedal negro hasta dejar la camilla a una altura deseada.
- Bajada: Pisar de manera continua el centro del pedal gris.

Trendelenburg / Antitrendelenburg (2):

- Trend: Pisar la zona del pedal gris más próxima al respaldo hará que la columna baje controladamente, hasta la altura deseada.
- Antitrend: Pisar la zona del pedal gris más próxima a las extremidades. Presionar el pedal de elevación para volver a la posición original de la camilla.

Quinta rueda (3):

- Se activa presionando el pedal trasero situado en la zona del piecero y se desactiva levantándolo.

Módulo del respaldo (4):

- Presionar la palanca manualmente acompañando el módulo para facilitar tanto la subida como la bajada.

Módulo de las extremidades (5):

- Tirar de la palanca situada debajo del módulo pies acompañándolo manualmente hasta la posición deseada.

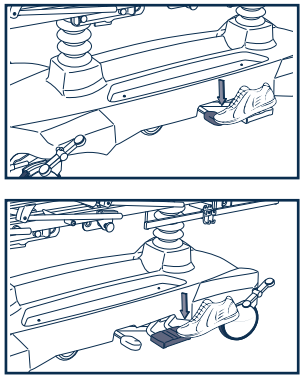

Pedales de subida y bajada

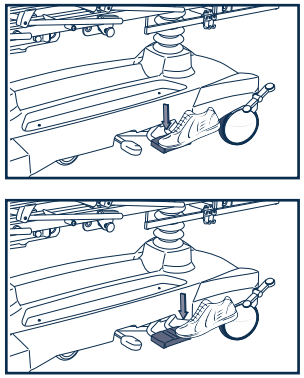

Trend / Antitrend

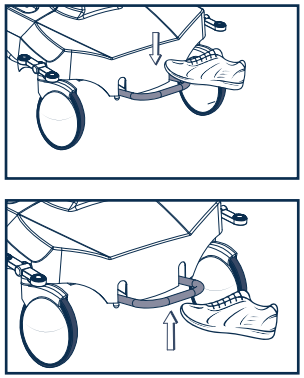

Quinta rueda



Módulo respaldo

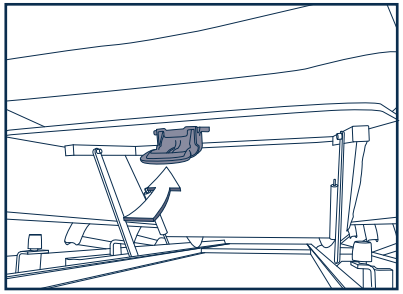

Módulo pies

Accesorios

Portasueros abatible incorporado:

- Varilla telescópica de fácil instalación en la parte superior de la camilla. Con regulación de altura y capacidad de sujeción de 4 kg.

Portasueros fijo:

- Fácilmente extraíble y se coloca en los sistemas de anclaje de las 4 esquinas.

Portadrenajes:

- Se ubican en los arquillos de los lados de la camilla, en la parte inferior del chasis.

Portaplacas Rx:

- Reduce las labores de transferencia de los pacientes y la carga de trabajo del personal sanitario.

Portamonitores:

- Mesita anclada a los soportes de accesorios de los tiradores de la camilla.

Portarrollos:

- Se coloca en la zona del piecero de la camilla y se fija a ella en los soportes para accesorios.



Portasueros abatible



Portasueros fijo



Portadrenajes



Portarrollos



Portaplacas Rx



Portamonitores

La empresa Industrias Hidráulicas Pardo S.L. cuenta con los siguientes certificados:

IQNET LTD · AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD · AENOR GESTIÓN CALIDAD DISEÑO DE PRODUCTOS SANITARIOS · AENOR GESTIÓN AMBIENTAL · AENOR ECODISEÑO · CE MD

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- En los movimientos de elevación y descenso de las partes móviles del lecho, con el resto de partes de la cama o los accesorios, se deberá comprobar que no se encuentra ningún obstáculo entre estos.
- El movimiento Trendelenburg y Antitrendelenburg debe realizarse siempre bajo supervisión médica.
- Cuando la cama se encuentre en su posición extendida no sentarse ni apoyarse en el extremo de los pies de la cama ya que podría producirse el volcado de la cama.

pardo

Industrias Hidráulicas Pardo, S.L. C/ Los Ángeles 5, (Polígono Centrovía) - 50198 La Muela, Zaragoza (Spain)