Cama NewCare V3

Ficha de consulta rápida

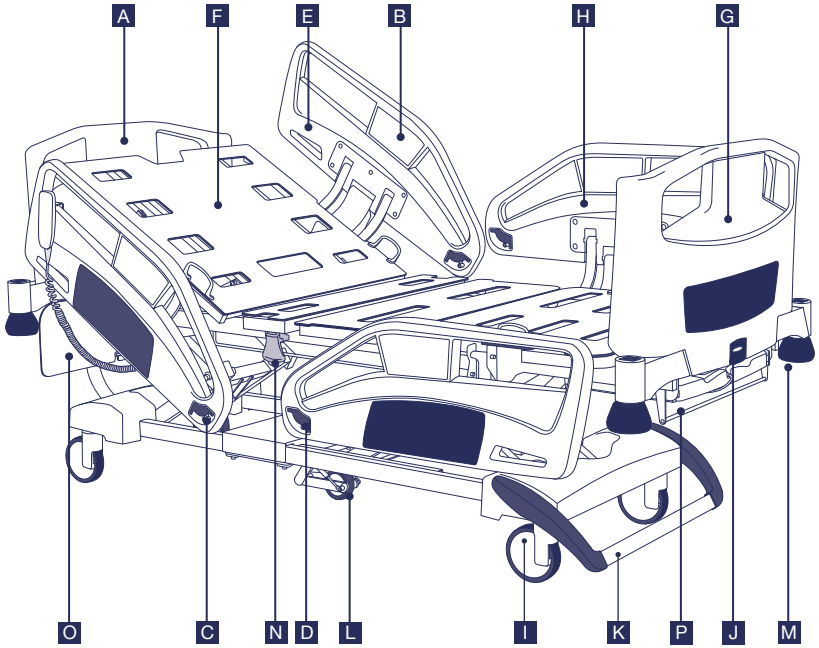

Componentes de la cama

A	Cabecero extraíble	I	Ruedas Ø15 cm
B	Control de membranas en las barandillas	J	Desbloqueo de cabeceros y pieceros
C	Indicador de inclinación respaldo	K	Pedal de frenado
D	Indicador de inclinación Trend y Antitrend	L	Quinta rueda
E	Barandillas de respaldo	M	Discos de protección
F	Lecho de HPL	N	Maneta CPR de emergencia
G	Piecero extraíble	O	Cabecero anclado
H	Barandillas de extremidades	P	Extensible de la cama

oct 2025 | CódPCO740839_FichaRapida_NewCareV3_ES_2020_rev03

www.pardo.es
SERVICIO TÉCNICO
(+34) 976 300 033

Otras funciones

Barandillas (1):

- Elevación: Tirar de la barandilla hacia arriba hasta que quede inmovilizada en su posición más alta.
- Descenso: Tirar del asa que se encuentra debajo de la barandilla hacia afuera. La barandilla bajará automáticamente.

CPR de emergencia (2):

- Accionar cualquiera de las dos palancas situadas en el centro de la cama, acompañándolo a su vez durante el descenso.

Pedal de freno (3):

- Freno: Pedal en posición baja.
- Giro libre: Pedal en posición horizontal.
- Direccional o 5ª rueda: Pedal en posición elevada.



Elevar barandillas





Descender barandillas



CPR de emergencia



Freno



Movimiento libre



Direccional o 5ª rueda

Limpieza

Limpieza y desinfección diaria con soluciones de cloro con una concentración de hasta 1000 mg/l:

- Barandillas, cabecero, piecero.

Limpieza y desinfección después de la salida de un paciente o antes de un traslado:

- Lecho de la cama, chasis de la cama.

Limpieza y desinfección a fondo cada dos meses:

- Soporte y elevación de la cama.

Mantenimiento

Comprobar siempre el estado correcto de:

- Cableado eléctrico.
- Ruedas.
- Mecanismos de frenado.

Para más información, diríjase al manual de uso y mantenimiento.

Mandos

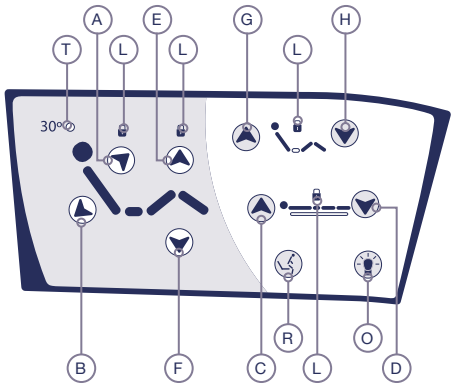

Membrana de paciente con bloqueos

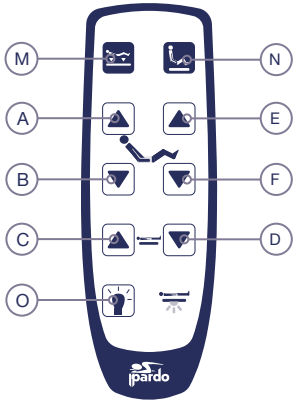

Mando de paciente con luz

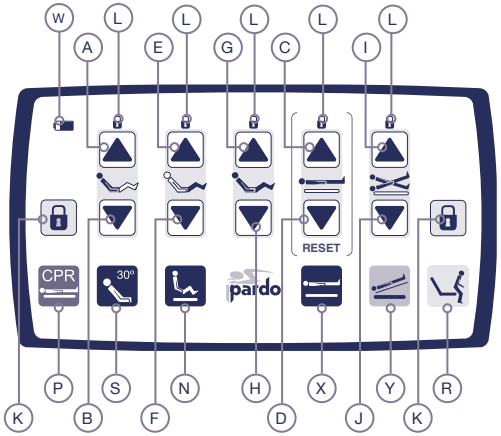

Mando de enfermería por cable ACO

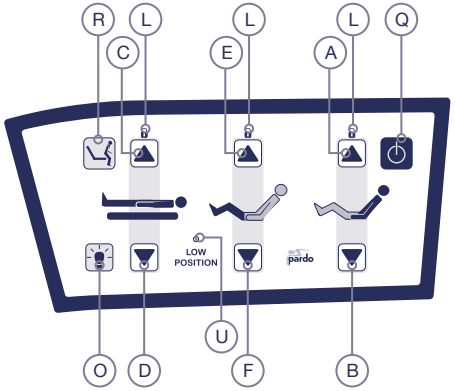

Membrana de barandillas

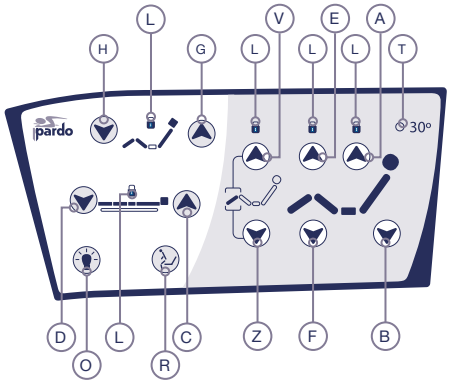

Mando enfermería para pies motorizados

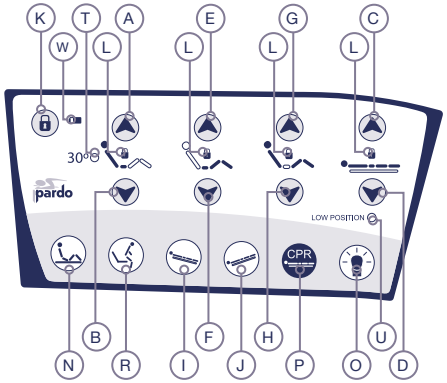

Membrana de enfermería con bloqueos

Instrucciones de uso

A	Subir respaldo	N	Posición silla cardíaca
B	Bajar respaldo	O	Luz bajo cama
C	Subir lecho	P	CPR de emergencia
D	Bajar lecho	Q	Botón Standby
E	Subir piernas	R	Posición Salida Segura
F	Bajar piernas	S	Posición respaldo 30º
G	Subir cuerpos simultáneamente *(autocontour)*	T	Led indicador respaldo 30º
H	Bajar cuerpos simultáneamente *(autocontour)*	U	Led indicador posición más baja
I	Antitrend	V	Elevación tramo pies
J	Trend	W	Indicador de batería
K	Bloqueo de movimientos	X	Posición exploración (altura máxima)
L	Led indicador de bloqueo de movimientos	Y	Posición Trend de emergencia
M	Posición Flat (bajada simultánea de cuerpos)	Z	Descenso tramo pies

La empresa Industrias Hidráulicas Pardo S.L. cuenta con los siguientes certificados:

IQNET LTD · AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD · AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SANITARIOS · AENOR GESTIÓN AMBIENTAL · AENOR ECODISEÑO · CE MD

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- En los movimientos de elevación y descenso de las partes móviles del lecho, con el resto de partes de la cama o los accesorios, se deberá comprobar que no se encuentra ningún obstáculo entre estos.
- La duración máxima de la maniobra continua no debe exceder los 2 minutos de lo contrario se pueden causar daños al equipo.
- El movimiento Trendelenburg y Antitrendelenburg debe realizarse siempre bajo supervisión médica.
- Cuando la cama se encuentre en su posición extendida no sentarse ni apoyarse en el extremo de los pies de la cama ya que podría producirse el volcado de la cama.
- No utilizar las manetas del accionamiento bilateral CPR para elevar el respaldo de la cama en ningún caso ya que podría producirse un fallo en el motor de elevación.

Industrias Hidráulicas Pardo, S.L. C/ Los Ángeles 5, (Polígono Centrovía) - 50198 La Muela, Zaragoza (Spain)